

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents
 United States Patent and Trademark
 Office
 Box PCT
 Washington, D.C.20231
 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 04 October 2000 (04.10.00)	
International application No. PCT/EP00/01149	Applicant's or agent's file reference 10580-GSI
International filing date (day/month/year) 11 February 2000 (11.02.00)	Priority date (day/month/year) 19 February 1999 (19.02.99)
Applicant KRAFT, Gerhard et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

16 August 2000 (16.08.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Claudio Borton Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	--



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 20 JUN 2001

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 10580-GSI		WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/01149	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11/02/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 19/02/1999	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G21K1/04			
Anmelder GESELLSCHAFT FÜR SCHWERIONENFORSCHUNG MBH			
<p>1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).</p> <p>Diese Anlagen umfassen insgesamt 10 Blätter.</p>			
<p>3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> I <input checked="" type="checkbox"/> Grundlage des Berichts II <input type="checkbox"/> Priorität III <input checked="" type="checkbox"/> Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit IV <input type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung V <input checked="" type="checkbox"/> Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung VI <input type="checkbox"/> Bestimmte angeführte Unterlagen VII <input type="checkbox"/> Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung VIII <input checked="" type="checkbox"/> Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 			
Datum der Einreichung des Antrags 16/08/2000		Datum der Fertigstellung dieses Berichts 18.06.2001	
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465		Bevollmächtigter Bediensteter Frisch, K Tel. Nr. +49 89 2399 2559 	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):
Beschreibung, Seiten:

1,4-31 ursprüngliche Fassung

2,3 eingegangen am 28/11/2000 mit Schreiben vom 27/11/2000

Patentansprüche, Nr.:

1-28 eingegangen am 28/11/2000 mit Schreiben vom 27/11/2000

Zeichnungen, Blätter:

1/9-9/9 ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- ☐ die gesamte internationale Anmeldung.
- ☒ Ansprüche Nr. 19-28.

Begründung:

- ☒ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 19-28 beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):
siehe Beiblatt
- ☐ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie hierzu nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):
- ☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
- ☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Eine sinnvolle internationale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

- ☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
- ☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

THIS PAGE BLANK (198710)

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-18
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-18
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-18
	Nein: Ansprüche	

**2. Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt**

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:
siehe Beiblatt

THIS PAGE BLANK (USPTO)

In diesem Bericht werden die im internationalen Recherchenbericht zitierte Druckschrift D1=EP-A-779.081, D2=EP-A-417.965, D3=GB-A-1.362.678, D4=WO-96/19262 und D5=EP-A-94.278 genannt.

Zum Teil III: kein Gutachten bezüglich der Ansprüche 19-28:

Die Ansprüche 19-28 betreffen jeweils ein Verfahren zum Ionenstrahl-Abtasten. Es ist aus der Beschreibung (siehe z.B. Seite 8, 2. Absatz; Seite 15, Zeilen 1-3) klar, daß ein solches Verfahren ein therapeutisches Verfahren zur Behandlung eines menschlichen Körpers umfaßt. Für solche therapeutische Verfahren muß kein Gutachten erstellt werden (Artikel 34.4.a.i und Regel 67.1.iv PCT).

Zum Teil V: Neuheit; erfinderische Tätigkeit; gewerbliche Anwendbarkeit:

1. Die in Anspruch 1 angegebene Formulierung "eine strahlintensitätskontrollierte Tiefen-Rasterung" impliziert kein Merkmal des beanspruchten Gegenstands in klarer Weise (Artikel 6 PCT); diese Formulierung gibt anscheinend lediglich die Wirkung der Absorptionskeile an und sie wird deshalb für die nachfolgende Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen. Auch die Wörter "schnell" ("in schneller Folge", "zum schnellen Antrieb") und "leistungsstark" ("einen leistungsstarken Linearmotor") werden nicht berücksichtigt (PCT Richtlinien III, 4.5).

D1 (Abbildungen 1, 6; Spalte 7, Zeile 54 - Spalte 8, Zeile 12) erwähnt ein Ionenstrahlabtastsystem mit den im Oberbegriff des Anspruch 1 aufgeführten Merkmalen (Ionenquelle, Ionenbeschleuniger 100, Ionenstrahlführung 170, Austrittsfenster, Ausrichtsystem 110). Das in D1 beschriebene System umfaßt darüber hinaus im Ionenstrahlgang zwischen Zielvolumen und Austrittsfenster quer zum Ionenstrahl angeordnete verschiebbare Absorptionskeile ("range shifters" 500). Durch Querverschiebung dieser Keile wird eine in die Tiefe gestaffelte Abtastung von Volumenelementen eines Tumorgewebes ermöglicht.

D1 erwähnt daher alle Merkmale des Anspruchs 1, die klar sind, außer daß in D1 anscheinend kein Linearmotor zum Antrieb der Absorberkeile erwähnt wird. Der in Anspruch 1 definierte Gegenstand, soweit dessen Merkmale klar sind, wird somit

THIS PAGE BLANK (USPTO)

als neu gegenüber diesem Stand der Technik angesehen (Artikel 33.2 PCT). Die übrigen im internationalen Recherchenbericht genannten Druckschriften erwähnen kein Ionenstrahl-Abtastsystem mit Absorberkeilen, die von einem Linearmotor quer zum Ionenstrahl angetrieben werden können.

Der in Anspruch 1 - sowie in den abhängigen Ansprüchen 2-18 - definierte Gegenstand wird daher als neu im Sinne von Artikel 33.2 PCT angesehen.

2. Der Unterschied zwischen dem in Anspruch 1 definierten Gegenstand und dem Stand der Technik gemäß D1 besteht darin, daß gemäß Anspruch 1 ein Linearmotor zum Antrieb der Absorptionskeile vorgesehen ist. In D1 ist lediglich impliziert, daß die Keile verschoben werden können, die genaue Antriebsmittel sind nicht angegeben. Es ist jedoch für den Fachmann naheliegend, für diesen Zweck einen Linearmotor einzusetzen; die Vorteile eines solchen Motors sind dem Antriebsfachmann geläufig. Der Unterschied kann daher keine erfinderische Tätigkeit begründen, so daß der in Anspruch 1 definierte Gegenstand die Erfordernisse des Artikel 33.3 PCT nicht erfüllt.
3. Die in den Ansprüchen 2-18 aufgeführten zusätzlichen Merkmale (Steuerung für den Antriebsmotor, Randblenden, Patiententisch, Ionisationskammer, Gantry) sind anscheinend alle an sich bekannt (siehe die Druckschriften D1-D5) und können in Kombination mit den Merkmalen des Anspruch 1 keine erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 33.3 PCT begründen.

Zum Teil VIII: Klarheit

Anspruch 2 impliziert kein zusätzliches Merkmal des beanspruchten Abtastsystems - das Zielvolumen ist nicht Teil des Systems. Auch die in Anspruch 10 angegebene Definition der Intensität impliziert kein Merkmal des Abtastsystems. Die in Anspruch 20 erwähnten Absorberkeile sind in Anspruch 19 nicht introduziert worden. Anspruch 19 entspricht nicht dem Anspruch 1: Anspruch 19 erwähnt weder Absorptionskeile noch Linearmotor.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT/EP00/01149

26.11.2000

Neue Patentansprüche

1. Ionenstrahl-Abtastsystem mit einer Ionenquelleneinrichtung, einem Ionenbeschleunigersystem, das auf eine für eine maximale Eindringtiefe notwendige Beschleunigung der Ionen einstellbar ist, und einer Ionenstrahlführung (1) mit Ionenstrahl-Austrittsfenster (2) für einen konvergierenden zentrierten Ionenstrahl (3) und einem mechanischen Ausrichtsystem(4) für das abzutastende Zielvolumen (5),
dadurch gekennzeichnet,

daß das Abtastsystem (6) ein Energieabsorptionsmittel (7) aufweist, das in dem Ionenstrahlengang zwischen Zielvolumen (5) und Ionenstrahl-Austrittsfenster (2) quer zum Ionenstrahlzentrum angeordnet ist und quer zum Ionenstrahlzentrum verschiebbliche Absorberkeile (13), einen leistungsstarken Linearmotor (8) zum schnellen Antrieb der Absorberkeile (13) und eine strahlintensitätskontrollierte Tiefen-Rasterung unter Querverschiebung des Energieabsorptionsmittels (7) aufweist, so daß eine in der Tiefe gestaffelte Abtastung von Volumenelementen (9) eines Tumorgewebes (11) in schneller Folge durchführbar ist.
2. Ionenstrahl-Abtastsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Zielvolumen (5) ein von gesundem Gewebe (10) umgebenes Tumorgewebe (11) ist, wobei die Eindringtiefe (12) des Ionenstrahls (3) durch die Energie der Ionen im Ionenstrahl (3) bestimmt ist und mittels der einstellbaren Beschleunigung der Ionen der tiefste Bereich des Tumorgewebes (11) erreichbar ist.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT/EP00/01149
26.11.2000

3. Ionenstrahl-Abtastsystem nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Abtastsystem ein elektronisches Steuersystem (14, 34) für den Linearantrieb der Absorberkeile (13) aufweist und eine Ionisationskammer (16) zum Messen der Teilchenrate des Strahles umfaßt und die Absorberkeile (13) nach Erreichen einer vorbestimmten Teilchenzahl, die für jeden Tiefenschritt verschieden sein kann, um einen Schritt, vorzugsweise von 10 µm bis 100 µm, weiter zusammenfährt, so daß eine in der Tiefe gestaffelte Abtastung von Volumenelementen (9) des Zielvolumens (5) möglich ist.
4. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Energieabsorptionsmittel (7) mindestens zwei quer zum Ionenstrahlzentrum entgegengesetzt verschiebbliche Absorberkeile (13) aufweist.
5. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Energie Absorptionsmittel (7) zwei quer zum Ionenstrahlzentrum (17) gegeneinander verschiebbliche Absorberkeilpakete (18) aufweist.
6. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das System einen Randbegrenzer (20) mit verschiebblichen Blendenelementen (21) zwischen dem Zielvolumen (5) und dem Energie Absorptionsmittel (7) aufweist.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT/EP00/01149
26.11.2000

7. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Abtastsystem irisblendenartig einzeln verstellbare Randblenden (19) zur teilweisen Randbegrenzung des Ionenstrahls (3) in bezug auf das Zielvolumen aufweist.
8. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Patiententisch (22) aufweist, der das Zielvolumen (5) trägt und der während eines Bestrahlungsvorganges in einer Ebene quer zum Ionenstrahl (3) in zwei Koordinateneinrichtungen verschiebbar ist.
9. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Patiententisch (22) aufweist, der das Zielvolumen (5) trägt und der während eines Bestrahlungsvorganges in einer lateralen Richtung quer zum Ionenstrahl (3) verschiebbar ist und Ablenkungsmagnete (23, 24, 25) aufweist, welche den Ionenstrahl (1) aus seiner Mittenposition am Austrittsfenster (2) quer zur lateralen Richtung des Patiententisches (22) ablenkt.
10. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Intensität der Ionenstrahlabtastung durch die Summenzahl der Ionen, die in einem Volumenelement (9) auf treffen, definiert ist.
11. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Ionisationskammer (16) zur Messung der Strahl Intensität auf-

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT/EP00/01149
26.11.2000

- weist, die stromaufwärts vom Energie Absorptionsmittel (7) angeordnet ist.
12. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Patiententisch (22) aufweist, der das Zielvolumen (5) trägt und während einer Bestrahlung in einer lateralen Richtung quer zum Ionenstrahl (3) verschiebbar ist und ein Gantry-System (27) aufweist, das quer zur lateralen Bewegungsrichtung des Patiententisches (22) um eine Gantryrotationsachse drehbar ist.
13. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System (27) zum Ausrichten eines Ionenstrahls (3) auf ein Zielvolumen (5) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Ionenstrahl (3) in der Gantryrotationsachse (28) dem Gantry-System (27) zugeführt und mittels Magnetoptiken (23, 24, 25) unter einstellbaren Winkeln von 0 bis 360° in einer Ebene orthogonal zur Gantryrotationsachse (28) auf ein Zielvolumen (5) ausrichtbar ist, so daß der Ionenstrahl (3) die Gantryrotationsachse (28) in einem Isozentrum (29) des Gantry-Systems (27) schneidet, wobei das Gantry-System (27) einen lateral in Richtung der Gantryrotationsachse (28) verschieblichen Zielvolumenträger (30) aufweist, das Zielvolumen (5) stromaufwärts des Isozentrums (29) angeordnet ist und ein Energieabsorptionsmittel (7), das stromaufwärts in Radialrichtung des Gantry-Systems (27) angeordnet ist, eine Volumenelementrasterung in Tiefenrichtung das Gantry-System (27) eine Drehwinkel-Volumenelementrasterung in Seitenrichtung und der lateral verschiebbliche Zielvolumenträger (30) eine Volumenelementrasterung in Längsrichtung definieren und beliebig ge-

THIS PAGE BLANK

PCT/EP00/01149
26.11.2000

formte Zielvolumen (5) durch Kombination dieser drei Rastermittel volumenelementweise rasterbar ist.

14. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Zielvolumenträger (30) während der Bestrahlung unbewegt bleibt und Umlenkmagnete (23 r 24, 25) den Ionenstrahl (3) während der Bestrahlung in der Gantry-Ebene ablenken.
15. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System nach einem der Ansprüche 13 bis 14, dadurch gekennzeichnete daß das Energie Absorptionsmittel (7) tangential zum Drehkreis des Gantry-Systems (27) verschiebbliche Absorberkeile (13) aufweist .
16. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnete daß das Energieabsorptionsmittel (7) mindestens zwei tangential zum Drehkreis des Gantry-Systems (27) entgegengesetzt verschiebbliche Absorberkeile (13) aufweist.
17. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System nach einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Energieabsorptionsmittel (7) radial gestaffelte tangential zum Drehkreis des Gantry-Systems (27) verschiebbliche Absorberkeilpakete (18) aufweist.
18. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System nach einem der Ansprüche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß ein zentraler Bereich des Ziel Volumens (5) um mindestens ein Fünftel des Gantry-Systemradius stromaufwärts des Isozentrums (29) angeordnet ist^ so daß das Zielvolumen (9) selbst nicht im Isozentrum (29) liegt.

THIS PAGE BLANK

PCT/EP00/01149
26.11.2000

19. Verfahren zum Ionenstrahl-Abtasten mittels einer Ionen-
quel-leneinrichtung, einem Ionenbeschleuniger-System und
einer Ionenstrahlführung (1) mit Ionenstrahl-
Austrittsfenster (2) für einen konvergierenden zentrier-
ten Ionenstrahl (3) und einem mechanischen Ausrichtsystem
(4) für das abzutastende Zielvolumen (5).

gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

Einstellen des Ionenbeschleuniger Systems auf eine für
eine maximale Eindringtiefe (12) notwendige Beschleuni-
gung der Ionen,

Erfassen der Ionenstrahl-Intensität,
Querverschieben eines Energieabsorbtionsmittels (7) mit
unterschiedlicher Materialstärke zur Tiefenmodulation des
Ionenstrahls (3),

Aufsummieren der Bestrahlungsionen eines Volumenelements
(9) eines Zielvolumens (5) bis zu einer vorgegebenen Be-
strahlungsdosis,

Ändern der Eindringtiefe des Ionenstrahls (3) mittels
Querverschiebung des Energie Absorptionsmittel s (7) nach
Erreichen der vorgegebenen Bestrahlungsdosis des Volumen-
elementes (9) zur Bestrahlung eines nächsten stromauf-
wärts liegenden Volumenelementes.

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß
ein elektronisches Steuersystem (14) für den Linearan-
trieb der Absorberkeile (13) die Teilchenrate des Strah-
les mittels einer Ionisationskammer (16) und die Absor-
berkeile (13) nach Erreichen einer vorbestimmten Teil-
chenrate, die für jeden Tiefenschritt unterschiedlich
sein kann, um einen Schritt, vorzugsweise um 10 bis 100
µm weiter zusammenfährt, so daß eine in der Tiefe gestaf-

THIS PAGE BLANK

PCT/EP00/01149
26.11.2000

felte Abtastung von Volumenelementen (9) des Zielvolumens (5) erfolgt.

21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Intensität zwischen 10^6 und 10^8 absorbierten Ionen pro Volumeneinheit beim Abrastern des Zielvolumens (5) eingestellt wird.
22. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 21, dadurch gekennzeichnete daß die Abtastung des Zielvolumenvolumens (5) kontinuierlich fortschreitet.
23. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 22, dadurch gekennzeichnete daß die Abtastung des Zielvolumens (5) in Tiefenrichtung säulenförmig erfolgt.
24. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtastung des Zielvolumens (5) schrittweise fortschreitet.
25. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtastung des Zielvolumens (5) in Tiefenrichtung kontinuierlich und in Seitenrichtung und Längsrichtung schrittweise erfolgt.
26. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtastung des Zielvolumenvolumens (5) in Tiefenrichtung und Seitenrichtung kontinuierlich und in Längsrichtung schrittweise erfolgt.
- 27 28. Verfahren zum Betreiben eines Ionenstrahl-Abtastsystems nach einem der Ansprüche 19 bis 26 unter Verwendung eines Gantry-Systems (27) zum Ausrichten eines Ionenstrahls (3) auf ein Zielvolumen (5), wobei der Ionenstrahl (3) in der

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT/EP00/01149
26.11.2000

Rotationsachse dem Gantry-System (27) zugeführt und mittels Magnetoptiken (23, 24, 25) unter einstellbaren Winkeln von 0 bis 360° in einer Ebene orthogonal zur Gantryrotationsachse (28) auf ein Zielvolumen (5) ausgerichtet wird, so daß der Ionenstrahl (3) die Gantryrotationsachse (28) in einem Isozentrum (29) des Gantry-Systems (27) schneidet, wobei das Gantry-System (27) einen Lateral in Richtung der

Gantryrotationsachse (29) verschieblichen Zielvolumenträger (30) aufweist,

gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte: Anordnen des Zielvolumens (5) stromaufwärts des Isozentrums (29),

Volumenelementrastern in Tiefenrichtung mittels eines Energieabsorptionsmittels (7), das stromaufwärts in Radialrichtung des Gantry-Systems (27) angeordnet ist, Volumenelementrastern in Seitenrichtung mittels Drehwinkeländerung des Gantry-Systems (27) und Volumenelementrastern in Längsrichtung mittels Lateral Verschiebung des Zielvolumenträgers (30).

28. Verfahren zum Betreiben eines Ionenstrahl-Abtastsystems nach einem der Ansprüche 19 bis 26 unter Verwendung eines Gantry-Systems (27), bei dem ein Zielvolumenträger (30) vor der Bestrahlung ausgerichtet wird und während der Bestrahlung unbeweglich bleibt und der Ionenstrahl (3) mittels der letzten Gantry-Umlenkmagnete (23, 24, 25) in der Gantry-Ebene zur Volumenelementrastern in Längsrichtung abgelenkt wird.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

mung eingesetzt, die aber das Problem nicht zufriedenstellend lösen können. Derartige Strahlformungsvorrichtungen arbeiten mit einem divergenten Ionenstrahl, der ein größeres Gebiet als das Zielvolumen, d.h. als das Volumen des Tumors, bestrahlt, aber durch entsprechende Randbegrenzer und durch die Tumorkontur nachbildende Kompensationsformen aus Kompensationsmaterialien den divergenten Ionenstrahl auf das Tumolvolumen einengen. Derartige Anlagen und Methoden haben den Nachteil, daß eine hohe Ionenstrahlenergie für den divergenten Ionenstrahl erforderlich wird und nicht gezielt einzelne Volumenelemente eines Zielvolumens oder Tumors angesteuert werden können.

Um einzelne Volumenelemente gezielt ansteuern zu können und eine Strahlendosis für das Volumenelement optimal anpassen zu können, wurde eine Rasterscanner Vorrichtung für Ionenstrahlen entwickelt. Mit dieser Vorrichtung wird das Zielvolumen in Schichten gleicher Teilchenreichweite zerlegt und ein feiner, intensitätsgesteuerter Bleistiftstrahl aus Ionen rasterförmig über die einzelnen Schichten geführt. Zusammen mit der aktiven Energievariation durch einen Ionenbeschleuniger kann damit ein exaktes Ausleuchten in drei Dimensionen eines jeden beliebigen Zielvolumens erreicht werden.

Jedoch auch diese intensitätsgesteuerte Rasterscanner Vorrichtung hat erhebliche Nachteile. Zum einen ist ein aufwendiges Kontrollsystem zur Überwachung der Strahllokalisierung im Mikrosekundenbereich erforderlich. Ferner besteht die Gefahr der Zerstückelung von Isoenergieschnitten durch Dichteeinhomogenitäten. Ferner ist die Einhaltung der vorgegebenen lateralen Strahllage (Strahlschwerpunkt) insbesondere bei der Variation von Energie und Strahlbreite während einer Behandlung problematisch. Schließlich sind die Randabfälle des Zielvolumens, die von der Breite des Strahlprofils abhängen, nachteilig für eine präzise Bestrahlung des Zielvolumens.

①, wie sie aus der Druckschrift EP 0779 081 A2 bekannt ist.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Diese Probleme führen dazu, daß die Einstellung und Kontrolle der Strahlparameter einer derartigen Vorrichtung ein Vielfaches der eigentlichen Patientenbestrahlung dauert. Darüber hinaus wird die Kombination von Rasterscansvorrichtung für Ionenstrahlen mit einem beweglichen drehbaren Ionenstrahlführungssystem der US-5,585,642, einem Gantry-System, wie es in Fachkreisen vorgeschlagen wird, eine erhebliche technische Herausforderung darstellen.

Bei einer Integration des Rasterscans in einem Gantry-System ^{<1>} werden die Kontrollen noch langwieriger und noch aufwendiger als bei einer bisher realisierten starren Strahlführung. Außerdem werden Magnete mit großen Aperturen für die Integration der vorgeschlagenen Rasterscansvorrichtung benötigt, um praxisgerechte Größen bei den Bestrahlungsfeldern zu erreichen. Zusammen mit einer schnellen Energievariation schließen die großen Aperturen dieses Lösungsvorschlags und damit die notwendige Abschirmung der Streufelder die Verwendung von supraleitenden Magneten aus. Eine Integration eines Scannersystems führt somit zu großen Aperturen, d.h. zu großen Ablenkungsmagneten und langen raum- und kostenaufwendigen Gantry-Systemen. Bei einer Anordnung des Scannersystems hinter dem letzten Ablenkungsmagneten, also stromabwärts der Ionenstrahlführung und eines Austrittsfensters des Ionenstrahls aus dem Führungssystem ^{<2>} sind zwar kleine Aperturen möglich, d.h. kompakte Magnete, können eingesetzt werden, dafür ergeben sich wegen der erforderlichen Driftlänge oder der lichten Weite für einen Behandlungsraum Gantry-Radien von über 7 m. In beiden Fällen müssen demnach nachteilig Massen von mehr als 100 Tonnen millimetergenau bewegt werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile im Stand der Technik zu überwinden und insbesondere im Vergleich zu der vorge-

①, wie sie aus der Druckschrift EP 0779 081 A2 bekannt ist,

②, wie es aus der Druckschrift EP 0779 081 A2 bekannt ist,

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

9/890897

PCT

5000

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

10

Applicant's or agent's file reference 10580-GSI	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP00/01149	International filing date (day/month/year) 11 February 2000 (11.02.00)	Priority date (day/month/year) 19 February 1999 (19.02.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G21K 1/04		
Applicant GESELLSCHAFT FÜR SCHWERIONENFORSCHUNG MBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 11 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☒ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

**CORRECTED
VERSION**

Date of submission of the demand 16 August 2000 (16.08.00)	Date of completion of this report 14 September 2001 (14.09.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/01149

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1,4-31, as originally filed,
 pages _____, filed with the demand,
 pages 2,3, filed with the letter of 28 November 2000 (28.11.2000),
 pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. _____, as originally filed,
 Nos. _____, as amended under Article 19,
 Nos. _____, filed with the demand,
 Nos. 2-28, filed with the letter of 28 November 2000 (28.11.2000),
 Nos. 1, filed with the letter of 29 August 2001 (29.08.2001).
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/9-9/9, as originally filed,
 sheets/fig _____, filed with the demand,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/01149

III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:

☐ the entire international application.

☒ claims Nos. 19-28

because:

☒ the said international application, or the said claims Nos. 19-28
relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (*specify*):

See supplemental sheet.

☐ the description, claims or drawings (*indicate particular elements below*) or said claims Nos. _____
are so unclear that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

THIS PAGE BLANK (USPTO)

☐ the claims, or said claims Nos. _____ are so inadequately supported
by the description that no meaningful opinion could be formed.

☐ no international search report has been established for said claims Nos. _____

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/01149

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of Box III:

THIS PAGE BLANK (10/27/10)

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III. 1

No opinion on Claims 19-28:

Claims 19-28 each relate to an ion beam scanning method. It is clear from the description (see e.g. page 8, second paragraph; page 15, lines 1-3) that such a method encompasses a method for treatment of the human body by therapy. No opinion is required on therapeutic methods of this kind (PCT Article 34(4)(a)(i) and Rule 67.1(iv)).

THIS PAGE BLANK (USPTO)

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-18	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-18	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-18	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

This report makes reference to the following document cited in the international search report:
D1: EP-A-0 779 081.

1. D1 is considered to be the closest prior art, as D1 (Figures 1 and 6; column 7, line 54 to column 8, line 12) mentions an ion beam scanning system with the features specified in the preamble of Claim 1 (ion source, ion accelerator 100, ion beam guide 170, outlet aperture, alignment system 110). The system described in D1 also encompasses movable absorption wedges ("range shifters" 500) which are disposed transversely to the ion beam in the ion beam path between the target volume and the outlet aperture.

D1 does not mention a linear motor to actuate the absorption wedges. Nor does D1 mention a feedback control circuit for driving the linear motor and having an ionisation chamber. The other documents cited in the international search report do not mention an ion beam scanning system with absorption wedges which can be actuated by a linear motor transversely to the ion beam. The subject matter

THIS PAGE BLANK (USPTO)

defined in Claim 1 is therefore considered to be novel over the relevant prior art (PCT Article 33(2)).

The subject matter defined in Claim 1, and in dependent Claims 2-18, is therefore considered to be novel (PCT Article 33(2)).

2. According to Claim 1 a linear motor is provided to actuate the absorption wedges and a feedback control circuit to control the linear motor. The feedback control circuit has an ionisation chamber which measures the particle rate in the beam upstream of the absorption wedges. This combination of features is not mentioned in any of the international search report citations. D1 merely implies that the wedges can be moved, but the precise means of actuating them are not indicated. The characterising features are not regarded as inherently self-evident. The subject matter defined in Claim 1 therefore involves an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3).
3. The subject matter defined in Claims 2-18 comprises all the features of Claim 1. These claims therefore also meet the requirements of novelty and inventive step according to PCT Article 33(1)-(3).

THIS PAGE BLANK (USPTO)

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

Clarity

Claim 2 does not define an additional feature of the scanning system claimed, since the target volume is not part of the system. The definition of intensity given in Claim 10 is likewise not a feature of the scanning system. The absorption wedges mentioned in Claim 20 were not introduced in Claim 19. Claim 19 does not correspond to Claim 1; it does not mention either absorption wedges or a linear motor.

Claim 1 has not been correctly delimited over the prior art described in D1 (PCT Rule 6.3(b)) - the absorption wedges mentioned in the characterising part of the claim were already described in D1 (Figure 6).

The description has not been brought into conformity with the present Claim 1 (PCT Rule 5.1(a)(iii)).

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 10580-GSI	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP00/01149	International filing date (day/month/year) 11 February 2000 (11.02.00)	Priority date (day/month/year) 19 February 1999 (19.02.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G21K 1/04, A61N 5/10		
Applicant GESELLSCHAFT FÜR SCHWERIONENFORSCHUNG MBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>6</u> sheets, including this cover sheet. <input checked="" type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of <u>10</u> sheets.
3. This report contains indications relating to the following items: I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input checked="" type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input checked="" type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 16 August 2000 (16.08.00)	Date of completion of this report 18 June 2001 (18.06.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/01149

I. Basis of the report

1. With regard to the **elements** of the international application:*☒ the international application as originally filed☒ the description:pages 1,4-31, as originally filed

pages _____, filed with the demand

pages 2,3, filed with the letter of 27 November 2000 (27.11.2000)☒ the claims:

pages _____, as originally filed

pages _____, as amended (together with any statement under Article 19

pages _____, filed with the demand

pages 1-28, filed with the letter of 27 November 2000 (27.11.2000)☒ the drawings:pages 1/9-9/9, as originally filed

pages _____, filed with the demand

pages _____, filed with the letter of _____

☐ the sequence listing part of the description:

pages _____, as originally filed

pages _____, filed with the demand

pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:☐ contained in the international application in written form.☐ filed together with the international application in computer readable form.☐ furnished subsequently to this Authority in written form.☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:☐ the description, pages _____☐ the claims, Nos. _____☐ the drawings, sheets/fig _____5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

THIS PAGE BLANK (U.S.)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/01149

III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

1. The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:

☐ the entire international application.

☒ claims Nos. 19-28

because:

☒ the said international application, or the said claims Nos. 19-28
relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (*specify*):

See supplemental sheet

☐ the description, claims or drawings (*indicate particular elements below*) or said claims Nos. _____
are so unclear that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

☐ the claims, or said claims Nos. _____ are so inadequately supported
by the description that no meaningful opinion could be formed.

☐ no international search report has been established for said claims Nos. _____

2. A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions:

☐ the written form has not been furnished or does not comply with the standard.

☐ the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III. 1

No opinion on Claims 19-28:

Claims 19-28 each relate to an ion beam scanning method. It is clear from the description (see e.g. page 8, second paragraph; page 15, lines 1-3) that such a method encompasses a method for treatment of the human body by therapy. No opinion is required on therapeutic methods of this kind (PCT Article 34(4)(a)(i) and Rule 67.1(iv)).

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 00/01149

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-18	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-18	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-18	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

This report makes reference to the following international search report citations:

D1 = EP-A-0 779 081
D2 = EP-A-0 417 965
D3 = GB-A-1 362 678
D4 = WO-A-96/19262
D5 = EP-A-0 094 278.

- The wording "beam intensity controlled depth scanning" in Claim 1 is not a clearly defined feature of the subject matter claimed (PCT Article 6). This wording merely appears to indicate the effect of the absorption wedges and has not therefore been considered in the assessment of novelty and inventive step below. The words "quick/rapid" ("in quick succession", "for rapid actuation") and "high-performance" ("a high-performance linear motor") have likewise not been considered (PCT Guidelines, Chapter III-4.5).

D1 (Figures 1 and 6; column 7, line 54 to column 8, line 12) mentions an ion beam scanning system with the features specified in the preamble of Claim 1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(ion source, ion accelerator 100, ion beam guide 170, outlet aperture, alignment system 110). The system described in D1 also encompasses movable absorption wedges ("range shifters" 500) which are disposed transversely to the ion beam in the ion beam path between the target volume and the outlet aperture. Transverse movement of these wedges enables volume elements of tumor tissue to be scanned at different depths.

D1 therefore mentions all the features of Claim 1 that are clear, although D1 does not appear to mention a linear motor to actuate the absorption wedges. The subject matter defined in Claim 1, insofar as its features are clear, is therefore considered to be novel over this prior art (PCT Article 33(2)). The other international search report citations do not mention an ion beam scanning system with absorption wedges which can be actuated by a linear motor transversely to the ion beam.

The subject matter defined in Claim 1, and in dependent Claims 2-18, is therefore considered to be novel (PCT Article 33(2)).

2. The difference between the subject matter defined in Claim 1 and the prior art according to D1 is that, in Claim 1, a linear motor is provided to actuate the absorption wedges. D1 merely implies that the wedges can be moved, but the precise means of actuating them are not mentioned. It is, however, obvious to a person skilled in the art to use a linear motor for this purpose. A person skilled in the art of actuating mechanisms will be familiar with the advantages of a motor of this kind. This

THIS PAGE BLANK (USPTO)

difference cannot therefore be considered to involve an inventive step. The subject matter defined in Claim 1 does not therefore meet the requirements of PCT Article 33(3).

3. The additional features listed in Claims 2-18 (control system for the actuating motor, boundary screens, patient treatment table, ionization chamber, gantry) all appear to be known *per se* (see documents D1-D5) and, combined with the features of Claim 1, do not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

THIS PAGE BLANK (USPTO)

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

Clarity

Claim 2 does not define an additional feature of the scanning system claimed, since the target volume is not part of the system. The definition of intensity given in Claim 10 is likewise not a feature of the scanning system. The absorption wedges mentioned in Claim 20 have not been introduced in Claim 19. Claim 19 does not correspond to Claim 1; it does not mention either absorption wedges or a linear motor.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 10580-GSI	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 00/ 01149	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11/02/2000	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 19/02/1999
Anmelder GESELLSCHAFT FÜR SCHWERIONENFORSCHUNG MBH		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.
☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der **Bezeichnung der Erfindung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der **Zusammenfassung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1

☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☒ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

☐ keine der Abb.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G21K1/04 A61N5/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G21K A61N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 779 081 A (HITACHI LTD) 18. Juni 1997 (1997-06-18) Spalte 3, Zeile 5 - Zeile 15	1-3, 5, 20
Y	Spalte 3, Zeile 51 - Zeile 56 Spalte 4, Zeile 44 - Zeile 48 Spalte 5, Zeile 33 - Zeile 37 Spalte 7, Zeile 54 - Spalte 8, Zeile 12	6, 9
A	Abbildungen 1, 6	4, 10, 11, 13-15, 21, 28, 29
Y	EP 0 417 965 A (GEN ELECTRIC) 20. März 1991 (1991-03-20) Spalte 9, Zeile 37 - Spalte 10, Zeile 39 Abbildungen 5-7A	6

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

30. Juni 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

06/07/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Capostagno, E

THIS PAGE BLANK (USPTO)

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	GB 1 362 678 A (VARIAN ASSOCIATES) 7. August 1974 (1974-08-07) Seite 2, Zeile 54 - Zeile 66 Abbildung 1 ----	9
A	WO 96 19262 A (ELEKTA AB ;BACKMAN PER (SE)) 27. Juni 1996 (1996-06-27) Seite 2, Zeile 13 -Seite 3, Zeile 23 Abbildung 3 ----	7
A	EP 0 094 278 A (THOMSON CSF) 16. November 1983 (1983-11-16) das ganze Dokument ----	8
A	EP 0 223 432 A (WANG SHIH PING) 27. Mai 1987 (1987-05-27) Spalte 11, Zeile 46 -Spalte 12, Zeile 5 Abbildung 8 -----	1,3,20

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/01149

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0779081	A	18-06-1997	JP	2833602 B	09-12-1998
			JP	9223600 A	26-08-1997
EP 0417965	A	20-03-1991	US	4998270 A	05-03-1991
			CA	2014920 A	06-03-1991
			JP	1848981 C	07-06-1994
			JP	3149036 A	25-06-1991
			JP	5055131 B	16-08-1993
GB 1362678	A	07-08-1974	CA	932883 A	28-08-1973
			DE	2158535 A	08-06-1972
			FR	2115423 A	07-07-1972
			IT	941769 B	10-03-1973
			NL	7116402 A	30-05-1972
			US	3720817 A	13-03-1973
			CA	939081 A	25-12-1973
			GB	1362679 A	07-08-1974
			US	3783251 A	01-01-1974
			CA	951031 A	09-07-1974
WO 9619262	A	27-06-1996	SE	508661 C	26-10-1998
			EP	0843578 A	27-05-1998
			SE	9404405 A	20-06-1996
EP 0094278	A	16-11-1983	FR	2526215 A	04-11-1983
			DE	3361543 D	30-01-1986
			US	4510613 A	09-04-1985
EP 0223432	A	27-05-1987	CA	1244971 A	15-11-1988
			JP	2913425 B	28-06-1999
			JP	5329138 A	14-12-1993
			JP	2562734 B	11-12-1996
			JP	5329139 A	14-12-1993
			JP	2849879 B	27-01-1999
			JP	5329140 A	14-12-1993
			JP	5080906 B	10-11-1993
			JP	62129034 A	11-06-1987
			JP	11164828 A	22-06-1999
			US	4953189 A	28-08-1990
			US	5054048 A	01-10-1991

THIS PAGE BLANK (USPTO)

BEST AVAILABLE COPY

PCT
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)




(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : G21K 1/04, A61N 5/10	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/49624 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 24. August 2000 (24.08.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/01149 (22) Internationales Anmeldedatum: 11. Februar 2000 (11.02.00) (30) Prioritätsdaten: 199 07 098.9 19. Februar 1999 (19.02.99) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): GESELLSCHAFT FÜR SCHWERIONENFORSCHUNG MBH [DE/DE]; Planckstrasse 1, D-64291 Darmstadt (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRAFT, Gerhard [DE/DE]; Planckstrasse 1, D-64291 Darmstadt (DE). WEBER, Ulrich [DE/DE]; Planckstrasse 1, D-64291 Darmstadt (DE). (74) Anwälte: BOETERS, Hans, D. usw.; Boeters & Bauer, Bereiteranger 15, D-81541 München (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i> <i>Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>

(54) Title: ION BEAM SCANNER SYSTEM AND OPERATING METHOD

(54) Bezeichnung: IONENSTRAHL-ABTASTSYSTEM UND VERFAHREN ZUM BETRIEB DES SYSTEMS

(57) Abstract

The invention relates to an ion beam scanner system with ion sourcing equipment, an ion accelerator system and ion beam guide, containing an outlet aperture for a converging, centred ion beam and a mechanical alignment system for the target volume which is to be scanned. For this purpose, the ion accelerator system can be set to the acceleration required for maximum penetration depth of the ions. In addition, the scanning system has an energy absorption element, which is mounted in the path of the beam crosswise to the centre of the beam, between the target volume and the ion beam outlet aperture. The energy absorption element can be displaced crossways to the centre of the ion beam to vary the beam's energy, so that modulation of the ion beam depth which is effected by a linear motor and transversal displacement of the energy absorption element can be carried out in rapid succession by depthwise graduated scanning on volumetric elements of the target volume. The invention also relates to a method for ion-beam scanning and to a method for operating an ion-beam scanner system using a gantry system.

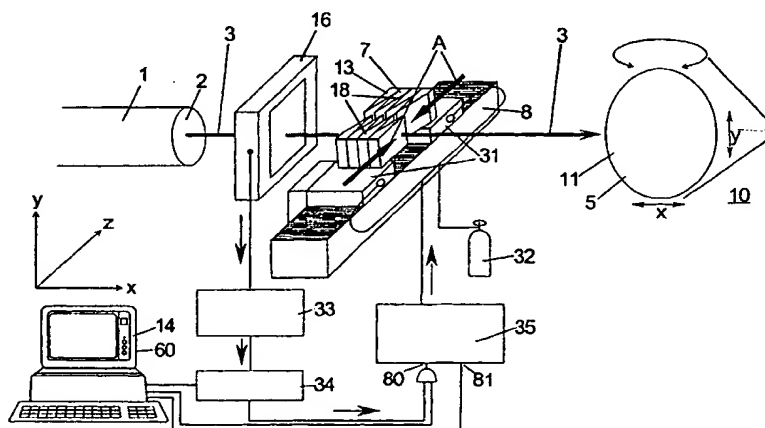

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Ionenstrahl-Abtastsystem mit einer Ionenquelleneinrichtung, einem Ionenbeschleunigungssystem und einer Ionenstrahlführung mit Ionenstrahl-Austrittsfenster für einen konvergierenden zentrierten Ionenstrahl und einem mechanischen Ausrichtungssystem für das abzutastende Zielvolumen. Dazu ist das Ionenbeschleunigungssystem auf eine für eine maximale Eindringtiefe notwendige Beschleunigung der Ionen einstellbar. Ferner weist das Abtastsystem ein Energieabsorptionsmittel auf, das in dem Ionenstrahlengang zwischen Zielvolumen und Ionenstrahl-Austrittsfenster quer zum Ionenstrahlzentrum angeordnet ist. Das Energieabsorptionsmittel ist quer zum Ionenstrahlzentrum zur Variation der Ionenstrahlenergie verschieblich, so daß eine Tiefenmodulation des Ionenstrahls, die mittels Linsensystem und der Querverschiebung des Energieabsorptionsmittels erfolgt, im Zielvolumen mit einer in der Tiefe gestaffelten Abtastung von Volumenelementen des Zielvolumens in schneller Folge durchführbar ist. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Ionenstrahl-Abtasten und ein Verfahren zum Betreiben eines Ionenstrahl-Abtastsystems unter Verwendung eines Gantry-Systems.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Ionenstrahl-Abtastsystem und Verfahren zum Betrieb des Systems

Die Erfindung betrifft ein Ionenstrahl-Abtastsystem und ein Verfahren zum Betrieb des Systems gemäß dem Oberbegriff der Ansprüche 1 und 20.

Ein derartiges System ist aus der Druckschrift US 5,585,642 bekannt und wird in der Teilchentherapie eingesetzt. Die mit einem derartigen System durchführbare Ionenstrahltherapie von Tumorgewebe zeichnet sich vor allem durch eine bessere Dosisverteilung, d.h. eine höhere Tumordosis, und eine Entlastung des gesunden Gewebes gegenüber einer Röntgentherapie aus. Diese Dosisverteilung folgt aus den physikalischen Eigenschaften von Teilchenstrahlen, die ein invertiertes Dosisprofil, d.h. ein Ansteigen der Dosis mit der Eindringtiefe, aufweist. Dadurch kann die Tumordosis über die konventionell mögliche Dosis der üblichen Bestrahlungstherapie gesteigert werden.

Um eine möglichst gute Anpassung des bestrahlten Volumens an das vorgegebene Zielvolumen zu erreichen, werden in der derzeitigen klinischen Praxis Vorrichtungen zur passiven Strahlfor-

mung eingesetzt, die aber das Problem nicht zufriedenstellend lösen können. Derartige Strahlformungsvorrichtungen arbeiten mit einem divergenten Ionenstrahl, der ein größeres Gebiet als das Zielvolumen, d.h. als das Volumen des Tumors, bestrahlt, aber durch entsprechende Randbegrenzer und durch die Tumorkontur nachbildende Kompensationsformen aus Kompensationsmaterialien den divergenten Ionenstrahl auf das Tumolvolumen einengen. Derartige Anlagen und Methoden haben den Nachteil, daß eine hohe Ionenstrahlenergie für den divergenten Ionenstrahl erforderlich wird und nicht gezielt einzelne Volumenelemente eines Zielvolumens oder Tumors angesteuert werden können.

Um einzelne Volumenelemente gezielt ansteuern zu können und eine Strahlendosis für das Volumenelement optimal anpassen zu können, wurde eine Rasterscanvorrichtung für Ionenstrahlen entwickelt. Mit dieser Vorrichtung wird das Zielvolumen in Schichten gleicher Teilchenreichweite zerlegt und ein feiner, intensitätsgesteuerter Bleistiftstrahl aus Ionen rasterförmig über die einzelnen Schichten geführt. Zusammen mit der aktiven Energievariation durch einen Ionenbeschleuniger kann damit ein exaktes Ausleuchten in drei Dimensionen eines jeden beliebigen Zielvolumens erreicht werden.

Jedoch auch diese intensitätsgesteuerte Rasterscanvorrichtung hat erhebliche Nachteile. Zum einen ist ein aufwendiges Kontrollsystem zur Überwachung der Strahllokalisation im Mikrosekundenbereich erforderlich. Ferner besteht die Gefahr der Zerstückelung von Isoenergieschnitten durch Dichte-Inhomogenitäten. Ferner ist die Einhaltung der vorgegebenen lateralen Strahlage (Strahlschwerpunkt) insbesondere bei der Variation von Energie und Strahlbreite während einer Behandlung problematisch. Schließlich sind die Randabfälle des Zielvolumens, die von der Breite des Strahlprofils abhängen, nachteilig für eine präzise Bestrahlung des Zielvolumens.

Diese Probleme führen dazu, daß die Einstellung und Kontrolle der Strahlparameter einer derartigen Vorrichtung ein Vielfaches der eigentlichen Patientenbestrahlung dauert. Darüber hinaus wird die Kombination von Rasterscansvorrichtung für Ionenstrahlen mit einem beweglichen drehbaren Ionenstrahlführungssystem der US-5,585,642, einem Gantry-System, wie es in Fachkreisen vorgeschlagen wird, eine erhebliche technische Herausforderung darstellen.

Bei einer Integration des Rasterscans in einem Gantry-System werden die Kontrollen noch langwieriger und noch aufwendiger als bei einer bisher realisierten starren Strahlführung. Außerdem werden Magnete mit großen Aperturen für die Integration der vorgeschlagenen Rasterscansvorrichtung benötigt, um praxisgerechte Größen bei den Bestrahlungsfeldern zu erreichen. Zusammen mit einer schnellen Energievariation schließen die großen Aperturen dieses Lösungsvorschlags und damit die notwendige Abschirmung der Streufelder die Verwendung von supraleitenden Magneten aus. Eine Integration eines Scannersystems führt somit zu großen Aperturen, d.h. zu großen Ablenkungsmagneten und langen raum- und kostenaufwendigen Gantry-Systemen. Bei einer Anordnung des Scannersystems hinter dem letzten Ablenkungsmagneten, also stromabwärts der Ionenstrahlführung und eines Austrittsfensters des Ionenstrahls aus dem Führungssystem sind zwar kleine Aperturen möglich, d.h. kompakte Magnete, können eingesetzt werden, dafür ergeben sich wegen der erforderlichen Driftlänge oder der lichten Weite für einen Behandlungsraum Gantry-Radien von über 7 m. In beiden Fällen müssen demnach nachteilig Massen von mehr als 100 Tonnen millimetergenau bewegt werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile im Stand der Technik zu überwinden und insbesondere im Vergleich zu der vorge-

schlagenen Rasterscanvorrichtung von Ionenstrahlen ein Ionenstrahlabtastsystem anzugeben, das die gegenwärtigen Schwierigkeiten überwindet.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 20 gelöst. Weitere Merkmale bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung werden in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

Zur Lösung der Aufgabe wird ein Ionenstrahl-Abtastsystem mit einer Ionenquelleneinrichtung, einem Ionenbeschleunigungssystem und einer Ionenstrahlführung mit Ionenstrahl-Austrittsfenster für einen konvergierenden zentrierten Ionenstrahl geschaffen, mit dem ein mechanisches Ausrichtssystem für das abzutastende Zielvolumen verbunden ist. Derartige Ausrichtsysteme sind aus dem Stand der Technik bekannt und sollen gewährleisten, daß das Zielvolumen aus beliebig bestimmbar Winkel im Raum bestrahlt werden kann. Deshalb weist üblicherweise ein derartiges Ausrichtssystem einen Patiententrägertisch auf, der mindestens um eine Rotationsachse drehbar und in drei Verschieberichtungen bewegbar ist, die nach dem Ausrichten während der Bestrahlung üblicherweise (zum Teil) nicht mehr verändert werden.

Bei dem erfindungsgemäßen Ionenstrahl-Abtastsystem ist das Ionenbeschleunigungssystem auf eine für eine maximale Eindringtiefe notwendige Beschleunigung der Ionen einstellbar, und das Abtastsystem weist ein Energieabsorptionsmittel auf, das in dem Ionenstrahlengang zwischen Zielvolumen und Ionenstrahl-Austrittsfenster quer zum Ionenstrahlzentrum angeordnet ist und quer zum Ionenstrahlzentrum zur Variation der Ionenstrahlenergie verschieblich ist. Dazu wird erfindungsgemäß zur Tiefenmodulation des Ionenstrahls das Energieabsorptionsmittel mittels eines Linearmotors quer zum Ionenstrahl verschoben, wobei im Zielvolumen eine in der Tiefe gestaffelten Abtastung von Volu-

menelementen des Zielvolumens vorteilhaft in schneller Folge durchführbar ist.

Dieses Ionenstrahl-Abtastsystem, das auf einer Tiefenmodulation basiert, bietet eine vorteilhafte Verbesserung gegenüber dem Einbau und der Integration eines Rasterscansystems in ein Gantry-System. Das erfindungsgemäße System ermöglicht gleich gute Dosisverteilung wie das Rasterscansystem, benötigt aber ein wesentlich weniger aufwendiges Kontrollsystem. Darüber hinaus erlaubt es eine kompakte Bauweise auch in Zusammenwirken mit supraleitenden Magneten, so daß mit diesem System beliebige Feldgrößen realisierbar werden. Schließlich wird mit diesem System eine größere Schonung des gesunden Gewebes oberhalb eines Tumorgewebes und insbesondere eine verbesserte Hautschonung erreicht. Darüber hinaus ist das erfindungsgemäße Ionenstrahl-Abtastsystem universell sowohl für starre Ionenstrahlführungssysteme als auch für drehbare Ionenstrahlführungssysteme einsetzbar.

In einer bevorzugten Ausführungsform des Ionenstrahlabtastsystems weist das Energieabsorptionsmittel quer zum Ionenstrahlzentrum verschiebbliche Absorberkeile auf, die mit einem leistungsstarken Linearmotor angetrieben werden, so daß eine strahlintensitätskontrollierte Tiefenraasterung vollzogen werden kann. Das Absorberkeilsystem moduliert die Eindringtiefe des Strahls durch Abbremsung, d.h., das Bragg-Maximum wird über der Tumortiefe moduliert. Die seitliche Auslenkung kann durch eine Patientenverschiebung in den zwei Richtungen beispielsweise in x- und in y-Richtung einer Ebene ausgeführt werden. Das hat den Vorteil, daß nur ein feiner Bleistiftstrahl von feststehender Energie durch die gesamte Ionenstrahlführung zu steuern ist. Die ortsfeste Lage des Strahls in diesem System kann vorteilhaft durch eine mechanisch feststehende Aperturblende garantiert werden und kann weiterhin durch kleine ortsauflösende

Zähler überprüft werden. Die Strahlintensität wird mit einer einfachen Ionisationskammer meßbar, um die Strahlendosis pro Volumenelement aufzusummieren.

In einer bevorzugten Ausführungsform weist das Abtastsystem ein elektronisches Steuersystem für den Linearantrieb der Absorberkeile und eine Ionisationskammer zum Messen der Teilchenrate des Strahls auf. Die Absorberkeile werden nach Erreichen einer vorbestimmten Teilchenzahl, die von der Ionisationskammer gemessen wird, und die durchaus für den Tiefenschritt verschieden sein kann, um einen Schritt, vorzugsweise von 10 bis 100 μm , weiter zusammengefahren, so daß eine in der Tiefe gestaffelte Abtastung von Volumenelementen des Zielvolumens möglich wird.

Mit dieser Ausführungsform ist der Vorteil verbunden, daß große ortsauflösende Detektoren, die das gesamte Strahlungsfeld abchecken, nicht benötigt werden. Das bedeutet eine erhebliche Reduktion des Kontrollsystems und eine Verkleinerung des Gesamtsystems.

Theoretisch kann das Absorberkeilsystem aus einem einzigen Absorberkeil bestehen, der quer zum Ionenstrahl schrittweise bewegt wird, und aufgrund seiner zunehmenden Dicke die Eindringtiefe des Ionenstrahls in das Gewebe oder das Zielvolumen vermindert. Dadurch entsteht eine säulenförmige Abtastung des Zielvolumens. Jedoch hat ein Absorberkeilsystem, das lediglich ein Absorberkeil aufweist, den Nachteil, daß über der Breite des Ionenstrahls die Absorption variiert und damit auch die Eindringtiefe variiert. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist deshalb das Energieabsorptionsmittel mindestens zwei quer zum Ionenstrahlzentrum entgegengesetzt verschiebbliche Absorberkeile auf. Diese beiden Absorberkeile haben den gleichen Absorberkeilwinkel, so daß beim schrittweisen Zusammenschieben der beiden Absorberkeile der Ionenstrahl immer

die gleiche Dicke eines Absorbermaterials durchfahren muß. Jedoch bilden sich auch hier minimale Energieunterschiede über dem Querschnitt des Ionenstrahls aus, da der Ionenstrahl selbst konvergiert und somit an den Absorberkeilflächen beim Übergang von einem Absorberkeil zum zweiten Absorberkeil einen unterschiedlichen Querschnitt aufweist und damit über dem Querschnitt unterschiedlich absorbiert wird.

Um diesen Effekt zu vermindern, weist vorzugsweise das Energieabsorptionsmittel zwei quer zum Ionenstrahlzentrum gegeneinander verschiebbliche Absorberkeilpakete auf. Bei derartigen Absorberkeilpaketen wird der Spalt zwischen zwei Absorberkeilen auf mehrere Spalte verteilt, bei denen sich die oben angegebene nachteilige Wirkung größtenteils bei entsprechender Anordnung der Absorberkeile zueinander aufhebt und die Steigung pro Keil gegenüber einem System mit zwei gegeneinander verschiebblichen Keilen vermindert wird.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist das Ionenstrahlabtastsystem einen Randbegrenzer mit verschiebblichen Blendenelementen zwischen dem Zielvolumen und dem Energieabsorptionsmittel auf. Eine derartige mechanische Randbegrenzung hat den Vorteil, daß steilere Randabfälle möglich werden, ohne daß ein aufwendiges Kontrollsystem erforderlich wird. Dazu weist vorzugsweise das Abtastsystems irisblendenartig einzeln verstellbare Randblenden für eine derartige Randbegrenzung des Ionenstrahl in bezug auf das Zielvolumen auf.

Um vorzugsweise das gesamte Zielvolumen zu bestrahlen, weist das Ionenstrahlabtastsystem einen Patiententisch auf, der das Zielvolumen trägt und während eines Bestrahlungsvorganges in einer Ebene quer zum Ionenstrahl in zwei Koordinatenrichtungen verschiebbar ist.

Mit dem erfindungsgemäßen Tiefenmodulationssystem wird das Zielvolumen primär in Säulen um die einzelnen Zielstrahlen zerlegt. Längs der Säule wird der Strahlweg in einzelne Positionen oder Pixel aufgeteilt, für die die Strahlbelegung bzw. die Strahlendosis vorberechnet wird. Mit einem mechanischen Abbremsystem zur Energieabsorption der Ionen, das aus einem Mehrfachkeil mit Linearantrieb besteht, wird das Bragg-Maximum des Strahls intensitätsgesteuert, ohne Unterbrechung von einem Pixel zum nächsten Pixel geführt, wenn die Teilchenbelegung der einzelnen Pixel erreicht ist. Diese Säulenaufteilung entspricht mehr den wirklichen Gegebenheiten einer Tumorbestrahlung, als die Flächenaufteilung der vorgeschlagenen Rasterscanvorrichtung, da Dichteinhomogenitäten stromaufwärts des Zielvolumens in, beispielsweise in der gesunden Gewebestruktur über einem Tumor, zu einer Verschiebung einer Säule in positiver oder negativer Richtung führen, aber nicht zu einer Unterbrechung innerhalb der Säule.

Zur Tumorbehandlung eines Patienten wird bei der erfindungsgemäßen Lösung vorteilhaft die höchste benötigte Energie für das Strahlenführungssystem vom Beschleuniger bis zum Patienten eingestellt. Diese Energieeinstellung bleibt in vorteilhafter Weise für die gesamte Behandlung konstant, da die Tiefenvariation, d.h. die Energievariation, nur durch das schnell bewegliche Absorberkeilsystem des Energieabsorptionsmittels direkt vor dem Patienten geschieht. Die Länge der einzelnen Bestrahlungssäulen hängt von der Geometrie des Zielvolumens ab. Der Dosisquerschnitt der Säulen ist ein Gauß-Profil. Die Abstände der Säulenzentren müssen kleiner sein als die halbe Halbwertsbreite der Gauß-Verteilung, um eine kontinuierliche Überlappung zu erzeugen. Um über- und unterbestrahlte Stellen auszuschließen, ist ein relativ breites Strahlprofil im Größenordnungsbereich von 10mm Durchmesser vorteilhaft. Diese im Vergleich zur vorgeschlagenen Rasterscanvorrichtung großen Strahlprofile setzen

auch die Bestrahlungsdauer pro Patient bei großen Zielvolumina herab.

Da durch den Randbegrenzer einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung Teile der radialen Dosisverteilung der einzelnen Dosissäulen absorbiert werden können, kann trotz großer Halbwertsbreiten ein steiler Randabfall an kritischen Stellen erreicht werden.

Während das Energieabsorptionsmittel in Form einer Tiefenmodulationsvorrichtung, bzw. eines Tiefenmodulators, bzw. eines Tiefenscanners aufgrund des Antriebs des Absorberkeilsystems mittels eines luftgelagerten Linearmotors schnell und säulenförmig das Zielvolumen abtasten kann, ist für die seitliche Verschiebung des Zielvolumens in den zwei Richtungen x und y einer Ebene genügend Zeit, so daß ein Patiententisch, der das Zielvolumen trägt und in zwei lateralen Richtungen quer zum Ionenstrahl während eines Bestrahlungsvorgangs verschiebbar ist, genügend Zeit, um nach und nach Säule für Säule abzutasten und nebeneinander zu überlappen.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der Patiententisch während der Behandlung nur in einer Koordinatenrichtung verschieblich, während für die andere laterale Richtung entsprechende Ablenkungsmagnete für den Ionenstrahl vorgesehen sind, so daß der Ionenstrahl aus seiner Mittenposition am Austrittsfenster quer zur lateralen Richtung des Patiententisches ablenkbar wird. Dieses System hat den Vorteil, daß es lediglich nur noch in einer Richtung von einer mechanischen und damit langsamen Bewegung abhängt und eine Tiefenmodulation und Seitenmodulation relativ zügig durchgeführt werden kann.

Vorzugsweise ist eine Ionisationskammer zur Summation der Ionen, die in einem Volumenelement auftreten, stromaufwärts vom

Energieabsorptionsmittel und stromabwärts vom Ionenstrahl-Austrittsfenster angeordnet. Mit dieser Anordnung kann die Bestrahlungsdosis, die als Summenzahl der Ionen, die in einem Volumenelement auftreten, definiert ist, vorteilhaft bestimmt werden.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist das Ionenstrahlabtastsystem zusätzlich zu einem in lateraler Richtung verschiebbaren Patiententisch ein Gantry-System auf, das quer zur lateralen Bewegungsrichtung des Patiententisches um eine Gantryrotationsachse drehbar ist. Durch die langsame Pendelbewegung des Gantry-Systems über das Bestrahlungsfeld werden die einzelnen Säulen nebeneinandergesetzt und damit vorteilhaft die zweite Dimension der tumorkonformen Bestrahlung ausgeführt.

Bei dem bevorzugten Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System wird der Ionenstrahl in der Gantryrotationsachse dem Gantry-System zugeführt und mittels Magnetoptiken unter einstellbaren Winkeln von 0 bis 360° in einer Ebene orthogonal zur Gantryrotationsachse auf ein Zielvolumen ausgerichtet. Der Ionenstrahl schneidet dabei die Gantryrotationsachse in einem Isozentrum des Gantry-System. Dabei weist das Gantry-System einen lateral in Richtung der Gantryrotationsachse verschiebblichen Zielvolumenträger auf, der stromaufwärts des Isozentrums angeordnet ist. Das Energieabsorptionsmittel ist stromaufwärts in Radialrichtung des Gantry-Systems angeordnet. Durch die erfindungsgemäße Tiefenmodulationsvorrichtung wird eine Volumenelementrasterung in Tiefenrichtung erreicht, durch das Gantry-System eine Drehwinkel-Volumenelementrasterung in Seitenrichtung und durch den lateral verschiebblichen Zielvolumenträger eine Volumenelementrasterung in Längsrichtung definiert, so daß beliebig geformte Zielvolumen durch die Kombination dieser drei Rastermittel volumenelementweise rasterbar sind.

Bei dieser bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist es wichtig, daß das Isozentrum der Gantrybewegung stromabwärts von, bzw. hinter dem Bestrahlungsvolumen liegt. Eine leichte Kegelförmigkeit des Bestrahlungsvolumens kann durch eine entsprechende Wichtung der Pixel bei einem dichten Netz der radialen Stützpunkte berücksichtigt werden, ohne daß ein Verlust an Homogenität auftritt.

Die Winkeldifferenz der exzentrischen Bestrahlung durch die Gantryrotation hat den entscheidenden Vorteil einer weiteren Absenkung der Dosisbelastung im Eingangskanal und damit einer Absenkung der Dosisbelastung des gesunden Gewebes über dem Tumorgewebe. Da sich das Gantry-System wegen der großen Masse nur kontinuierlich oder in kleinen Schritten bewegen kann, muß die angebotene Teilchenfluenz höher als die pro Säule benötigte Fluenz liegen. Das bedeutet, die Bestrahlung jeder einzelnen Säule vollzieht sich während einer kurzen Winkelbewegung des Gantry-Systems. Die dritte Koordinate der Bestrahlung erfolgt bei dieser bevorzugten Ausführungsform durch eine langsame, schrittweise Verschiebung des liegenden Patienten auf dem Zielvolumenträger durch die Bestrahlungsapparatur in Richtung der Gantryrotationsachse. Dabei werden vorzugsweise Geschwindigkeiten von weniger als 1 cm/s eingehalten und sind ausreichend für tolerable Bestrahlungszeiten von Patienten.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung bleibt der Zielvolumenträger während der Behandlung unbewegt und der Ionenstrahl wird durch die Umlenkmagnete während der Bestrahlung in der Gantry-Ebene abgelenkt. Damit wird, statt die Patientenliege zu verschieben, der Ionenstrahl durch Variation des Magnetfeldes im letzten Umlenkmagneten in der Gantry abgelenkt. Es ergibt sich damit vorteilhaft folgende Abfolge der notwendigen Bewegung in drei Freiheitsgraden: die Strahla-

blenkung mit der höchsten Geschwindigkeit geschieht mit dem Energieabsorptionsmittel, bzw. Tiefenmodulator. Eine mittlere Geschwindigkeit (z.B. alle 1 bis 2 s um 4 mm), wird der Strahl in der Gantry-Ebene durch die Umlenkmagneten zur nächsten Säule geführt. Die langsamste Bewegung ist die Gantryrotation, die nach der Bestrahlung einer Säulenreihe durch die Drehung des Gantry-Systems auf die nächste Säulenreihe geführt wird. Der Vorteil bei diesem Ionenstrahl-Abtastsystem ist es, daß der Patient nicht bewegt werden muß und das Gantry-System während der Bestrahlung nicht hin- und herschwingen muß, sondern schrittweise gedreht werden kann.

Gegenüber herkömmlichen Systemen erfordert die variable Ablenkung des Strahls in der Gantry-Ebene nur einen relativ geringen Zusatzaufwand, da die Umlenkmagnete sowieso notwendig sind. Die Veränderung der Ablenkung des Strahls erfolgt langsam (im Sekundentakt) und somit werden auch keine hohen Anforderungen an die Magnetnetzteile und das Kontrollsystem gestellt. Als Kontrollvorrichtung für die Ablenkungsvariation des Strahls genügt eine einfache Drahtkammer, die mit einer relativ geringen Wiederholungsrate ausgelesen werden muß. Die Kontrollelektronik für diese langsame Abtasttechnik der vorliegenden Erfindung ist bei weitem nicht so aufwendig, wie die vorgeschlagene, konkurrierende, schnelle Rasterscantechnik, bei der die Strahlpositionen alle 100 μ s zu messen sind, um den Strahl verfolgen und kontrollieren zu können.

In einer bevorzugten Ausführungsform des Ionenstrahl-Abtastsystems mit Gantry-System weist das Energieabsorptionsmittel tangential zum Drehkreis des Gantry-Systems verschiebbare Absorberteile auf. Diese Ausführungsform wird dadurch erreicht, daß das Energieabsorptionsmittel unmittelbar an dem Gantry-System fixiert wird, nämlich stromabwärts von dem Austrittsfenster des Ionenstrahls. Auch in dieser Ausführungsform

des Ionenstrahl-Absorptionssystems mit Gantry-System können statt einem Absorberkeil mindestens zwei tangential zum Drehkreis des Gantry-Systems entgegengesetzt verschiebbliche Absorberkeile vorgesehen werden oder radial gestaffelte tangential zum Drehkreis des Gantry-Systems verschiebbliche Absorberkeilpakete angeordnet werden.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Ionenstrahl-Abtastsystems mit Gantry-System ist ein zentraler Bereich des Zielvolumens um mindestens $1/5$ des Gantry-Systemradius stromaufwärts des Isozentrums angeordnet, so daß das Zielvolumen selbst nicht im Isozentrum liegt. Die Vorteile dieser Ausführungsform wurden bereits oben im Detail geschildert. Dabei ist hervorzuheben, daß ein optimaler Abstand zwischen Zielvolumen und Isozentrum einstellbar ist, um die Belastung des gesunden Gewebes im Eingangskanal der Bestrahlung gering zu halten.

Bei dem bevorzugten Verfahren zum Ionenstrahlabtasten mittels einer Ionenquelleneinrichtung, einem Ionenbeschleunigungssystem und einer Ionenstrahlführung mit Ionenstrahl-Austrittsfenster für einen konvergierenden, zentrierten Ionenstrahl und einem mechanischen Ausrichtsystem für das abzutastende Zielvolumen werden folgende Verfahrensschritte durchgeführt:

- Einstellen des Ionenbeschleunigungssystems auf eine für eine maximale Eindringtiefe notwendige Beschleunigung der Ionen,
- Erfassen der Ionenstrahlintensität,
- Querverschieben eines Energieabsorptionsmittels mit unterschiedlicher Materialstärke zur Tiefenmodulation des Ionenstrahls,

- Aufsummieren der Strahlungsionen eines Volumenelementes eines Zielvolumens bis zu einer vorgegebenen Strahlungs-dosis,
- Ändern der Eindringtiefe des Ionenstrahls mittels Querverschiebung des Energieabsorptionsmittels nach Erreichen der vorgegebenen Bestrahlungsdosis des Volumenelementes zur Bestrahlung eines nächsten stromaufwärts liegenden Volumenelements.

Mit diesem Verfahren ist der Vorteil verbunden, daß die Beschleunigung der Ionen in dem Ionenbeschleunigungssystem nur einmal festzulegen ist und während der gesamten Behandlungsphase beibehalten werden kann. Die Tiefenmodulation der Bestrahlung wird ausschließlich durch ein Energieabsorptionsmittel, das stromaufwärts des zu bestrahlenden Zielvolumens angeordnet ist, und stromabwärts des Ionenstrahl-Austrittsfensters liegt, durchgeführt. Da es außer dem Energieabsorptionsmittel, bzw. dem Tiefenmodulator kein weiteres Material im Strahlengang gibt, bevor das Gewebe erreicht wird, ist die nukleare Fragmentierung minimal und unabhängig von der Eindringtiefe, da die Gesamtabsorption durch den Tiefenmodulator plus Gewebetiefe insgesamt konstant bleibt. Somit wird ein konstantes Bragg-Profil über der Zielvolumentiefe erreicht. Eine Verwendung von Spezialfiltern, auch Ripple-Filtern, zur Vergleichmäßigung des Bragg-Profiles, wie es herkömmliche Verfahren einsetzen, ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren entbehrlich.

Die Bewegung der Absorberkeile wird für die Tiefenmodulation von der Intensität des einkommenden Strahls nach der berechneten Vorlage der Dosisverteilung geregelt. Dabei ist die Länge jeder Bestrahlungssäule in einzelne Bildpunkte aufgeteilt und der Strahl, d.h. das Bragg-Maximum des Strahls, wird vorteilhaft von einem Pixel, bzw. Bildpunkt, zum nächsten verschoben, wenn die erforderliche Teilchenzahl erreicht ist. Somit bietet das erfindungsgemäße Verfahren eine größtmögliche Sicherheit

für den Patienten und eine hohe Präzision bei der Bestrahlung von Tumorgewebe sowie eine minimale Belastung des stromaufwärts liegenden gesunden Gewebes.

In einer bevorzugten Durchführung des Verfahrens fährt ein elektronisches Steuersystem für den Linearantrieb der Absorberkeile diese um einen Schritt weiter zusammen, nachdem es die Teilchenrate des Strahles mittels einer Ionisationskammer gemessen hat, und eine vorbestimmte Teilchenanzahl, die für jeden Tiefenschritt unterschiedlich sein kann, erreicht worden ist. Somit erfolgt eine in der Tiefe gestaffelte Abtastung von Volumenelementen des Zielvolumens. Vorzugsweise ist die Schrittweite, mit der die Absorberkeile weiter zusammengefahren werden, zwischen 10 und 100 μm .

Die gemessene Intensität pro Volumenelement liegt zwischen 10^6 und 10^8 absorbierten Ionen während des Abrasterns des Zielvolumens. Dabei kann das Zielvolumen kontinuierlich fortschreitend abgetastet werden, indem während der Tiefenmodulation gleichzeitig in den anderen beiden Richtungen der Patiententisch oder die Gantry oder beides bewegt wird. Zwar erfolgt aufgrund der Tiefenmodulation die Abtastung des Zielvolumens in Tiefenrichtung immer säulenförmig, jedoch können diese Säulen bei einer kontinuierlich fortschreitenden Abtastung zickzackförmig verschoben sein.

In einer anderen bevorzugten Durchführung des Verfahrens schreitet die Abtastung des Zielvolumens schrittweise voran. Dieses schrittweise Voranschreiten ist insbesondere vorteilhaft, wenn die Bewegungsabläufe mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufgrund von unterschiedlichen Massen, die zu bewegen sind, ablaufen.

Entsprechend kann vorzugsweise die Abtastung des Zielvolumens in Tiefenrichtung kontinuierlich und in Seiten- und Längsrichtung schrittweise erfolgen oder die Abtastung des Zielvolumens in Tiefenrichtung und in Seitenrichtung kontinuierlich und in Längsrichtung schrittweise erfolgen. Bei einer bevorzugten Durchführung des Verfahrens wird das Ionenstrahl-Abtastsystem unter Verwendung eines Gantry-Systems betrieben. Dazu werden folgende Verfahrensschritte durchgeführt:

1. Anordnen des Zielvolumens stromaufwärts des Isozentrums,
2. Volumenelementrastern in Tiefenrichtung mittels eines Energieabsorptionsmittels, das stromaufwärts in Radialrichtung des Gantry-Systems angeordnet ist,
3. Volumenelementrastern in Seitenrichtung mittels Drehwinkeländerung des Gantry-Systems und
4. Volumenelementrastern in Längsrichtung mittels Rasterverschiebung des Zielvolumenträgers.

Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß der Zielvolumenträger oder der Patiententisch lediglich in eine Richtung während der Bestrahlung bewegt werden muß, während die anderen beiden Richtungen einerseits durch die Tiefenmodulation mit Hilfe des Energieabsorptionsmittels erreicht wird, und die andere durch Dreh- oder Pendelbewegung des Gantry-Systems durchgeführt wird.

Während für das Verschieben des Absorberkeilsystems des Energieabsorptionsmittels relativ geringe Massen mit einem Linear- motor zu bewegen sind, erfolgt die Drehbewegung eines Gantry- Systems entsprechend langsamer, während ein Verschieben eines Patiententisches aufgrund seiner geringeren Masse gegenüber einem Gantry-System, aber größeren Masse gegenüber dem Energieab-

sorptionsmittel mit seiner Trägheit zwischen diesen beiden Vorrichtungen liegt.

Bei einem weiteren bevorzugten Verfahren kann der Patient in völliger Ruhe auf dem Patiententisch liegen, wenn ein Gantry-System Verwendung findet, bei dem ein Zielvolumenträger vor der Behandlung ausgerichtet wird und während der Bestrahlung unbeweglich bleibt und der Ionenstrahl mittels der letzten Gantryumlenkmagnete in der Gantry-Ebene zur Volumenelementrasterung in Längsrichtung abgelenkt wird.

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung werden nun anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer ersten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 2 zeigt das Prinzip der Überlagerung von zueinander verschobenen Tiefendosisprofilen,

Fig. 3 zeigt das Prinzip der säulenförmigen Abtastung eines Zielvolumens mit der Ausführungsform nach Fig. 1,

Fig. 4 zeigt die perspektivische Ansicht eines Energieabsorptionsmittels in Form eines einzelnen Absorberkeils,

Fig. 5 zeigt den Querschnitt eines Energieabsorbermittels mit zwei Absorberkeilen,

Fig. 6 zeigt den Querschnitt eines Energieabsorptionsmittels mit Absorberkeilpaketen aus jeweils fünf Absorberkeilen,

Fig. 7 zeigt einen Randbegrenzer in Ruhestellung,

Fig. 8 zeigt einen Randbegrenzer mit zwei Blenden in Betriebsposition,

Fig. 9 zeigt eine Prinzipsskizze eines luftgelagerten Linearmotors,

Fig. 10 zeigt eine Prinzipskizze einer zweiten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 11 zeigt eine Prinzipskizze der Anordnung eines Zielvolumens in der Ausführungsform nach Fig. 10 oberhalb des Isozentrums,

Fig. 12 zeigt eine Prinzipskizze einer dritten Ausführungsform der Erfindung.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer ersten Ausführungsform eines Ionenstrahl-Abtastsystems, das eine nichtgezeigte Ionenquelleneinrichtung, ein nichtgezeigtes Ionenbeschleunigungssystem und eine Strahlführung 1 mit einem Ionenstrahl-Austrittsfenster 2 für einen konvergierenden zentrierten Ionenstrahl 3 umfaßt. Zu dem Ionenstrahl-Abtastsystem gehört ein nichtgezeigtes mechanisches Ausrichtsystem für das abzutastende Zielvolumen 5.

Das Ausrichtsystem ermöglicht es, das Zielvolumen mindestens um eine Achse zu drehen und in Richtung der drei Raumkoordinaten zu verschieben, so daß das Zielvolumen aus einem beliebig wählbaren Winkel im Raum von dem Ionenstrahl bestrahlt werden kann. Eine derartige Ausrichtung erfolgt vor der eigentlichen Bestrahlung des Zielvolumens mit Ionen.

Mit dem nicht gezeigten Ionenbeschleunigungssystem wird zunächst eine für eine maximale Eindringtiefe notwendige Beschleunigung der Ionen eingestellt. Diese Energie wird während der gesamten Behandlung nicht geändert und bewirkt, daß der Ionenstrahl bis zu dem tiefsten Punkt des Zielvolumens das Gewebe durchdringen kann. Durch ein Energieabsorptionsmittel 7, das in dem Ionenstrahlengang zwischen Zielvolumen 5 und Ionenstrahl-Austrittsfenster 2 quer zum Ionenstrahlzentrum angeordnet ist und quer zum Ionenstrahlzentrum zur Variation der Ionenstrahlenergie in Pfeilrichtung A verschieblich ist, wird das Bragg-Maximum von der maximalen Eindringtiefe durch zunehmende Energieabsorption zu niedrigeren Eindringtiefen verschoben. Dieser Vorgang kann kontinuierlich oder schrittweise durchgeführt werden, so daß eine Tiefenmodulation oder eine Tiefenabtastung stattfindet, die im folgenden auch Tiefenscan genannt wird. Die Änderung der Energieabsorption wird mittels des Energieabsorptionsmittels 7 dadurch erreicht, daß ein Linearmotor 8 eine Querverschiebung in Pfeilrichtung A von paarweise gegenüberstehenden Absorberkeilen 13 aufeinander zu bewirkt, so daß ein in der Tiefe gestaffeltes Abtasten von Volumenelementen des Zielvolumens in schneller Folge durchführbar wird.

Dazu sind die Läufer 31 des Linearmotors 8 luftgelagert und werden von einer Preßluftflasche 32 mit Druckluft versorgt. Für ein schrittweises Zusammenfahren der Absorberkeile 13 werden die Motorströme über eine Schrittmotorsteuerung 35, die eine Leistungsstufe aufweist, gesteuert.

Um die Anzahl der Ionen zu messen und aufzusummieren, bis eine vorbestimmte Ionenstrahldosis pro Volumenelement des Zielvolumens erreicht ist und bis der Linearmotor 8 um einen weiteren Schritt die Absorberkeile 13 vorzugsweise um 10 bis 100 µm zusammenfahren kann, wird mit der Ionisationskammer 16 über einen Stromverstärker mit nachgeschaltetem Spannungs-Frequenz-

Konverter 33 eine Impulssteuerung mit TTL-Impulsen angesteuert, deren Frequenzproportional zur einfallenden Ionenrate (onen/sec) ist. Sobald die ausreichende Dosis für ein Volumenelement erreicht ist, was einer bestimmten TTL-Impulszahl entspricht, löst die Impulssteuerung mit einem Steuerimpuls an die Schrittmotorsteuerung den nächsten Schritt aus. Dieser Ablauf wiederholt sich, bis ein Tiefenscan abgeschlossen ist.

Fig. 2 zeigt das Prinzip der Überlagerung von zueinander verschobenen Tiefendosisprofilen. Durch den Tiefenscanner werden die einzelnen Bragg-Kurven 36 bis 44 von einer zur nächsten Absorberstellung um jeweils 4,3 mm verschoben. Die Höhe der Bragg-Kurven ist durch die Teilchenanzahl gegeben, die bei entsprechender Absorberstellung auf das Target auftrifft. Wenn die Teilchenzahlen vorher korrekt berechnet wurden, ergibt die Überlagerung der Bragg-Kurven die gewünschte verbreiterte Bragg-Spitze, die der Ausdehnung des Zielvolumens in der Tiefe entspricht. Entsprechend ist auf der Abszisse die Eindringtiefe in cm angegeben und auf der Ordinate die relative Dosis in %.

Deutlich ist an diesem Beispiel erkennbar, daß bei der Aufsummation der Bragg-Kurven das Zielvolumen mit 100 % relativer Dosis bestrahlt wird, während das darüberliegende gesunde Gewebe unter 60 % der Strahlenbelastung ausgesetzt ist, und das darunterliegende Gewebe sogar weit unter 20 % der Strahlendosis aufnehmen muß. Damit wird deutlich, welcher großer Vorteil gegenüber Röntgenstrahltherapien die Ionenstrahltherapie aufweist.

Die Fig. 2 soll das Prinzip der Überlagerung lediglich verdeutlichen. Bei einem realen Tiefenscan werden mehrere tausend Bragg-Kurven mit viel kleineren Abständen überlagert. Dieses ermöglicht eine quasi kontinuierliche Bewegung der Antriebe des Energieabsorptionsmittels 7 und gewährleistet somit eine gleichmäßige Überlagerung, so daß auf konventionelle Ripple-

Filter bei Einsatz des Ionenstrahl-Abtastsystems nach dieser Ausführungsform der Erfindung verzichtet werden kann.

Fig. 3 zeigt das Prinzip der säulenförmigen Abtastung eines Zielvolumens mit der Ausführungsform nach Fig. 1. Bei dieser Ausführungsform wird das Zielvolumen in Pfeilrichtung X und Y mechanisch verschoben, während der Ionenstrahl 3 einer starren Ionenstrahlführung seine zentrale Richtung beibehält. Durch die Tiefenmodulation oder den Tiefenscan verursacht durch das Energieabsorptionsmittel werden die Volumenelemente 9 des Zielvolumens 5 säulenförmig abgetastet, wobei die Ausdehnung 1 der verbreiterten Bragg-Spitze aufgrund der Summation der Bragg-Kurven 36 bis 43 der Länge der Säule bzw. der Tiefe des Zielvolumens an dieser Stelle entspricht. Wie Fig. 3 deutlich zeigt, kann ein gesundes Gewebe 10 von einer Bestrahlung weitestgehend verschont bleiben, während das Tumorgewebe die unterschiedlichsten Formen einnehmen kann, so daß lediglich die Tiefenmodulation der Ausdehnung des Tumorgewebes in einer Koordinatenrichtung, beispielsweise entlang der z-Koordinate, folgen muß.

Fig. 4 zeigt die perspektivische Ansicht eines Energieabsorptionsmittels in Form eines einzelnen Absorberkeils. Dieser Absorberkeil ist ein Einzelkeil aus einem Absorberkeilpaket, wie es in Fig. 6 gezeigt wird. Der Absorberkeilwinkel α liegt zwischen 6° und 10° und ist in diesem Ausführungsbeispiel auf $8,765^\circ \pm 0,01$ festgelegt. Die Länge des Absorberkeils beträgt zwischen 100 und 150mm und ist in diesem Ausführungsbeispiel auf $120 \pm 0,02$ mm festgelegt. Die größte Dicke des Absorberkeils beträgt zwischen 15 und 30mm und ist in diesem Ausführungsbeispiel auf $19 \pm 0,01$ mm angesetzt. Der quaderförmige Abschluß des Absorberkeils dient dazu, ihn in einem Paket, wie es in Fig. 6 gezeigt wird, zu stapeln. Der quaderförmige Abschluß hat die Abmessungen $15 \times 15\text{mm}^2$ bis $30 \times 30\text{mm}^2$ und eine Länge von 40 bis

60 mm, die in diesem Beispiel 50mm beträgt. Der Quaderquerschnitt ist der größten Absorberkeiltiefe von 19 mm angepaßt und beträgt in diesem Beispiel $20 \times 20\text{mm}^2$. Eine zentrale Bohrung 44 ermöglicht das Zusammenfügen mehrerer Einzelkeile zu Absorberkeilpaketen, wie sie in Fig. 6 gezeigt werden.

Fig. 5 zeigt den Querschnitt eines Energieabsorptionsmittels mit zwei Absorberkeilen 13, die in Pfeilrichtung A aufeinander zu oder in Pfeilrichtung B auseinander fahrbar sind. Werden diese zwei Absorberkeile auseinandergefahren, so ergibt sich ein großer Abstand a zwischen den schrägen Absorberkeilflächen. Aufgrund des konvergierenden zentrierten Ionenstrahls 3 wird deutlich, daß der Ionenstrahlbereich auf der rechten Seite des Strahls ein dickeres Absorbermaterial zu durchstrahlen hat, als auf der linken Seite des Strahls. Somit ist die Eindringtiefe in das Zielvolumen über den Querschnitt des Ionenstrahls gesehen unterschiedlich. Um dieses auszugleichen und zu minimieren, wird in Fig. 6 der Querschnitt eines Energieabsorptionsmittels 7 mit Absorberkeilpaketen 18 aus jeweils fünf Absorberkeilen 13 gezeigt. Deutlich ist zu erkennen, daß die rechte Seite des konvergenten Ionenstrahls kaum mehr Absorbermaterial zu durchdringen hat, als die linke Seite. Somit ist eine Tiefenmodulation mit Hilfe von Absorberkeilpaketen 18 einer Tiefenmodulation aus zwei Absorberkeilen 13, wie in Fig. 5 gezeigt, vorzuziehen.

Vorzugsweise bestehen die Absorberkeile 13 aus mehreren Plexiglaskeilen. Aufeinandergesetzt besitzen sie als Absorberkeilpaket 18 die gleiche Wirkung wie zwei Absorberkeile 13 der Fig. 5, jedoch mit unterschiedlicher Steigung. Eine große Steigung ist bei zwei Absorberkeilen, wie in Fig. 5 notwendig, um bei der erreichbaren Beschleunigung der Absorberkeile 13 einen ausreichenden Absorbereffekt zu erzielen. diese große Steigung

wird in Fig. 6 auf eine Mehrzahl von Absorberkeilen mit kleiner Steigung verteilt.

Der Vorteil von mehreren aufeinandergesetzten gegenüber zwei dicken Absorberkeilen 13 liegt darin, daß der Strahl in den Absorberkeilen unvermeidlich aufgestreut wird, und bei den zwei dicken Absorberkeilen ein Teil des Strahls durch mehr Material als ein anderer Teil des Strahls läuft. Dadurch erzeugt man eine undefinierte Energieverteilung des Strahls, die zu vermeiden wäre. Die Absorberkeile 13 werden mit Aluminiumwinkeln auf dem Linearmotoren 8 befestigt. Die Verschraubungen sind spielfrei und präzise.

Das Plexiglas als Material der Absorberkeile 13 hat den Vorteil, präzise bearbeitbar zu sein und aus radiologischer Sicht dem Material Wasser recht ähnlich zu sein. Demnach verhält sich für einen Ionenstrahl aus Kohlenstoff eine 1 cm dicke Plexiglasschicht genauso wie eine 1,15 cm dicke Wasserschicht. Bei einer Verwendung von 2 x 4 Absorberkeilen mit einem Steigungswinkel von $\alpha = 8,765^\circ$ ergibt sich ein Vorschub durch die Motoren um 1 mm eine Verdickung des Absorbers um eine wasseräquivalente Strecke von 1,42 mm Wasser.

Das Ionenstrahl-Abtastsystem gemäß der vorliegenden Erfindung stellt hohe Anforderungen an das System zur Tiefenmodulation und die Beweglichkeit des Energieabsorptionsmittels 7. Das Energieabsorptionsmittel, bzw. der Tiefenscanner soll mit einem Schwerionenstrahl ein glattes Tiefendosisprofil mit einer typischen Ausdehnung von 2 bis 15 cm in der Tiefe erzeugen. Dazu werden Absorberkeile verwendet, die so verschoben werden können, daß die Strecke, die der Strahl durchläuft, verändert wird. Der Tiefenscanner variiert während der Strahlextraktion die Absorberdicke in genau definierter Weise. Die Schwerionenstrahlen, die durch unterschiedlich dicke Absorptionseinstel-

lungen gelaufen sind, werden dabei überlagert und erzeugen in der Addition das gewünschte Tiefendosisprofil.

Damit in der Überlagerung keine Abweichungen von der Vorgabe auftreten, muß bei jeder Absorberkeildickeneinstellung eine genau definierte Ionenstrahlmenge oder Teilchenmenge auf das Target treffen. Das bedeutet, wenn die Absorberkeile zulange oder zu kurz in einer bestimmten Stellung verharren, ergeben sich Abweichungen vom gewünschten Tiefen-Dosis-Profil. Um derartige Abweichungen zu vermeiden, muß der Ionenstrahlstrom als Funktion der Zeit gemessen werden und je nach gemessener Anzahl der Ionen sind die Absorberkeile ständig mit hoher Präzision und unterschiedlicher Schrittgeschwindigkeit zu verschieben.

Da der Ionenstrahlstrom insbesondere bei Schwerionen, die durch ein Ionenbeschleunigersystem, vorzugsweise einem Synchrotron, beschleunigt wurden, nicht konstant ist, sondern sehr starke Fluktuationen zeigt, hat dieser unregelmäßige Ionenstrahlstrom zur Folge, daß die Absorberkeile 13 auch mit sehr unregelmäßiger Geschwindigkeit teilweise ruckartig verschoben werden müssen. Dies stellt eine extreme Anforderung an Präzision und Dynamik des Antriebs und der Steuerung für ein derartiges Energieabsorptionsmittel 7 dar, so daß vorzugsweise folgende Parameter einzuhalten sind:

Extraktionszeit:	2 - 4 s
Tiefendosisprofil:	2 - 15 cm
Maximale Geschwindigkeit:	1 - 2 m/s
Beschleunigung:	20 - 30 m/s ²
Genauigkeit:	100 - 200 µm

Verwendet werden dazu Absorberkeilpakete, wie sie in Fig. 6 gezeigt werden.

Um den Vorschub der Absorberkeile möglichst synchron zur gemessenen Ionenstrahlintensität zu führen, muß die Meß- und Steuerungselektronik relativ schnell reagieren. Die Reaktionszeit, also die Summe der Verzögerungszeitkonstanten von der Ionisationskammer 16, dem Stromverstärker 33 und der Schrittmotorsteuerung 35, wie in Fig. 1 gezeigt werden, ist folglich kleiner als 1 ms.

Eine geringere Anforderung an die Dynamik wird für den Randbegrenzer 20 gefordert. Bild 7 zeigt einen Randbegrenzer in Ruhestellung. Er besteht in diesem Beispiel aus sechs einzelnen rechteckigen Wolframplatten 45 bis 50, die individuell in Richtung auf das Zentrum aus ihrer in Fig. 7 gezeigten Ruhestellung geschoben werden können. Dazu sind die Wolframplatten 45 bis 50 in ihrer Höhe versetzt angeordnet, so daß sie sich beim Zusammenschieben nicht behindern. Nähert sich der Ionenstrahl dem Rand eines Tumorgewebes, bzw. Zielvolumens 5, so kann die entsprechende Randblende 19, wie in Fig. 8 gezeigt, verschoben werden, so daß eine scharfe Randbegrenzung für den relativ breiten Ionenstrahl ermöglicht wird. Im Prinzip kann bereits durch drei in der Höhe gestaffelte Blenden aus rechteckigen Wolframplatten ein beliebiger Rand des Gewebes begrenzt werden, jedoch haben sechs Platten den Vorteil der größeren Variationsmöglichkeit.

Fig. 9 zeigt eine Prinzipskizze eines luftgelagerten Linearmotors 8, auf dem jeweils ein Absorberpaket 18 eines Energieabsorptionsmittels 7 befestigt werden kann. Ein derartiger Linearmotor ist ein permanent-erregter Zweiphasen-Reluktanzmotor und besteht aus zwei Baueinheiten, dem ortsfesten Stator 51 und einem luftgelagerten beweglichen Teil dem Läufer 52.

Ein Läufer beinhaltet mindestens zwei Magnetsysteme 53 und 54 mit je einem Permanentmagneten 55 als Konstantflußquelle. Durch

einen Stromfluß in den Wicklungen 56 kann der magnetische Fluß in den Schenkeln gesteuert werden, das bedeutet, in einem Schenkel wird ein Fluß verstärkt und in dem zugehörigen anderen Schenkel geschwächt. Eine Kraftwirkung in Bewegungsrichtung resultiert aus der Energieänderung des magnetischen Feldes im Luftspalt zwischen Stator 51 und Läufer 52. Werden die beiden Wicklungen der Magnetsysteme 53 und 54 mit seitlich versetzten sinusförmigen Strömen betrieben, wird ein Gleichlaufverhalten bzw. eine bestimmte Position für jedes Stromverhältnis erreicht. Das Läuferelement ist in X-Richtung angeordnet, so daß lineare Bewegungen erfolgen können. Das Statorelement 51 besteht aus strukturierten Weicheisenstreifen, die auf Stahlkörpern, Mineralguß, natürliches Hartgestein oder auch auf leichte Glasfaser oder Kohlenstofffaserhohlkörper aufgeklebt werden.

Zur Erreichung einer aerostatischen Luftlagerung ist jeder Läufer 52 mit Luftlagerdüsen ausgestattet. Aufgrund elektromagnetischer Kraftwirkung zwischen Läufer 52 und Stator 51 ist die Luftlagerung stark vorgespannt, so daß bei Betriebsdruck der Luftspalt sehr konstant ist. Die Lebensdauer ist vorteilhafterweise prinzipiell unbegrenzt, denn Reibung und Verschleiß treten nicht auf. Schmiermittel sind auch nicht erforderlich. Das erleichtert die vorzugsweise Anwendung in medizinischen Bereichen.

Für eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ionenstrahl-Abtastsystems wurde der Linearmotor so ausgelegt, daß sich zwei Motoren auf demselben Stator in entgegengesetzter Richtung in Pfeilrichtung A, wie in Fig. 1 gezeigt, bewegen. Dazu hat der Stator die Maße 64 mm x 64 mm x 1 m Länge, wovon nur etwa 50 cm Länge für den Tiefenscanner benötigt werden. Ferner besitzt der Stator eine Lamellenstruktur mit einer Periode von 1,28 mm. Die Motoren sind luftgelagert und arbeiten im Prinzip wie eine Magnetschwebbahn. Die technischen Daten der Motoren sind:

Masse:	700 g
Maximale Haltekraft:	100 N
Maximale Geschwindigkeit:	2 m/s
Maximale Beschleunigung:	40 m/s ²
Positioniergenauigkeit:	10 µm
Wiederholgenauigkeit:	3 µm
Führungsgenauigkeit:	5 µm
Luftdrucklagerung:	3,5 bar

Die Schrittmotoransteuerung 35, wie sie in Fig. 1, Position 35 gezeigt, wird, ist für einen Tiefenscanner bzw. einen Tiefenmodulator vorteilhaft geeignet. Die Schrittmotorsteuerung 35 hat eine einfache effektive Schnittstelle, die im wesentlichen nur aus 2 TTL-Eingängen 80, 81 besteht, die einen Schrittbefehl oder einen Richtungsbefehl geben. Bei einem Schrittbefehl werden mit jedem einlaufenden TTL-Impuls an einem ersten Eingang 80 die Motorströme der Leistungsstufe so geändert, daß sich die Motoren gegenläufig um 20µm in diesem Ausführungsbeispiel weiterbewegen. für einen Richtungsbefehl bestimmt der Pegel (TTL) an dem zweiten Eingang 81 die Richtung, nämlich auseinanderlaufend oder zusammenlaufend.

Die Ionisationskammer 16, wie sie aus in Fig. 1 gezeigt wird, gibt die Anzahl der Teilchen (Schwerionen) an, die pro Sekunde vom Beschleuniger extrahiert werden. Diese Größe unterliegt starken zeitlichen Schwankungen und muß deshalb in Echtzeit gemessen werden. Eingesetzt wird hierzu eine Parallelplatten-Transmissions-Ionisationskammer mit ca. 1cm Gasstrecke (Stickstoff-CO₂-Gemisch, 80 % : 20 %), die bei 1600 V betrieben wird. Der Strom, der am Ausgang der Kammer gemessen werden kann, ist bei feststehender Teilchenenergie proportional zum Strahlstrom. Bei typischen Strahlströmen des Beschleunigers liegen die Ströme aus der Ionisationskammer im Bereich von µA.

Die Ansprechgeschwindigkeit des Detektors wird durch die Driftzeit der ionisierten Detektorgasmoleküle (Ionenrumpfe) in der Ionisationskammer 16 begrenzt und hat eine Verzögerungskonstante von ca. 100 μ s.

Die Meßelektronik im Stromverstärkerblock 33 wandelt den Strom aus der Ionisationskammer in eine proportionale Frequenz von TTL-Impulsen um. Aus dem Stromsignal wird ein Spannungssignal im Voltbereich erzeugt. Durch eine Amplitudenfrequenzumwandlung werden aus dem Spannungssignal TTL-Impulse erzeugt, deren Frequenz proportional zur Spannung ist. Dabei entsprechen 4 MHz etwa 10 V.

Bei gegebener Verstärkung des Stromverstärkers 33 der Fig. 1 entspricht demnach ein TTL-Impuls einer bestimmten Ladung, die in der Ionisationskammer erzeugt wurde. Diese wiederum wurde von einer bestimmten Teilchenzahl erzeugt. Die Anzahl der erzeugten TTL-Impulse ist also proportional zur Anzahl der Schwerionen, die durch die Ionisationskammer 16 fliegen. Der Proportionalitätsfaktor läßt sich experimentell auf ± 3 % genau bestimmen und hängt von der Teilchenenergie und der Verstärkung ab.

Die Impulssteuerung 34 in Fig. 1 ist im Prinzip ein variabler Impulsratenumsetzer. Die Steuerung hat einen Speicher, der in mehrere Bereiche eingeteilt werden kann. Über den angeschlossenen PC kann vor der Bestrahlung in die einzelnen Bereiche jeweils eine Zahlenreihe geladen werden. Die Anzahl der Zahlen entspricht der Anzahl der Positionen, die die Linearmotoren für einen tiefen Scan einnehmen sollen. In der Praxis sind dies einige tausend Positionen pro Bereich.

Wenn die Bestrahlung gestartet wird, zählt die Impulssteuerung die Impulse, die von der Meßelektronik kommen, und gibt ihrerseits einen Impuls an die Schrittmotorsteuerung 35 aus, wenn die Impulszahl für die erste Position erreicht wird. Dann wird der Zähler auf 0 zurückgesetzt und wiedergezählt, bis die Pulszahl für die zweite Position erreicht wird, worauf wieder ein TTL-Impuls ausgegeben wird. Dieses wiederholt sich, bis die letzte Position erreicht wurde. Dann gibt die Impulssteuerung ein Stop-Signal an die Beschleuniger, woraufhin die Strahlextraktion in wenigen μ s abgebrochen wird.

Direkt im Anschluß daran kann der nächste Speicherbereich mit einer anderen Zahlenreihe aktiviert werden, um einen anderen Tiefenscan zu fahren. Der Rechner 60 dient zum Laden der Zahlenreihen in die Pulssteuerung. Außerdem kann der Rechner über eine Indexkarte die Schrittmotorsteuerung 35 direkt ansteuern. Damit können vor dem eigentlichen Tiefenscan die Motoren automatisch in ihre Referenzposition oder Startposition bewegt werden.

Fig. 10 zeigt eine zweite Ausführungsform der Erfindung. Der Tiefenscanner 70 entspricht dabei dem Tiefenscanner in Bauform und Wirkungsweise der Fig. 1. Jedoch wird in dieser bevorzugten Anwendung ein Gantry-System eingesetzt, das den Ionenstrahl 3 um eine Gantryrotationsachse 28 rotieren lassen kann. Mit dem Tiefenmodulator oder Tiefenscanner 70 kann das Zielvolumen 5 in Säulenform abgetastet werden und durch Drehen des Gantry-Systems um wenige Winkelgrade kann das Zielvolumen seitlich abgetastet werden. Ein besonderer Vorteil dieser Anordnung ist die Möglichkeit, das Zielvolumen oberhalb des Isozentrums 29 des Gantry-Systems 27 anzuordnen. Damit wird der Einlaufkanal für den Ionenstrahl stromaufwärts divergent, das bedeutet, daß sowohl die Haut eines Patienten als auch das gesunde Gewebe weniger belastet wird, weil die Ionenstrahl-Bestrahlung im Be-

reich oberhalb des Zielvolumens 5 auf ein größeres Volumen verteilt wird. Durch den Einsatz des Gantry-Systems nach Abbildung 10 muß der Zielvolumenträger 30 nur noch in eine Richtung bewegt werden, vorzugsweise in Richtung der Gantryrotationsachse 28, wie es die Pfeilrichtungen C zeigen.

Fig. 11 zeigt eine Prinzipskizze der Anordnung eines Zielvolumens 5 in der Ausführungsform nach Fig. 10 oberhalb des Isozentrums 29. Deutlich erkennbar ist in dieser Prinzipskizze die Gantryrotationsrichtung D, in der das Zielvolumen 5 nacheinander säulenförmig mit Hilfe des Tiefenscanners 70 tiefengescannt wird. Für jedes Volumenelement 9 wird die Anzahl der Ionen in der Ionisationskammer 16 gemessen und in der Nähe der Ränder des Tumorgewebes kann mit Hilfe der Randbegrenzung 20 ein scharfer Randabfall, falls erforderlich, eingestellt werden. Deutlich erkennbar ist auch, daß sich die Bestrahlung des gesunden Gewebes 10 über dem Tumorgewebe auf ein größeres Volumen verteilt, so daß die Strahlenbelastung des gesunden Gewebes verringert wird.

Während bei diesem System, das in den Figuren 10 und 11 dargestellt wird, der Zielvolumenträger 30 zur vollständigen Bestrahlung des Zielvolumens in Längsrichtung bewegt werden muß, zeigt Fig. 12 eine Prinzipskizze einer dritten Ausführungsform der Erfindung, bei der nach dem Ausrichten des Targetvolumens in Relation zu dem Isozentrum keine weitere mechanische Bewegung des Zielvolumens erforderlich ist. Bei der Ausführungsform nach Fig. 12 wird anstelle des Zielvolumenträgers der Ionenstrahl mit Hilfe der Ablenkungsmagnete 23, 24 und 25 der Ionenstrahlführung in dem Gantry-System in der Strahlführungsebene des Gantry-Systems abgelenkt, was keinen erheblich größeren Aufwand für die Ströme in den Ablenkungsmagneten bedeuten, zumal eine Neukonstruktion der Ablenkungsmagnete nicht erforderlich ist, da der Ionenstrahl in Richtung des Dipolspaltes der

letzten Ablenkungsmagnete abgelenkt würde. Bei diesem System kommt der gleiche Tiefenscanner 70, wie bei der ersten und zweiten Ausführungsform der Erfindung nach Fig.1 und Fig. 10 zum Einsatz.

Patentansprüche

1. Ionenstrahl-Abtastsystem mit einer Ionenquelleneinrichtung, einem Ionenbeschleunigersystem und einer Ionenstrahlführung (1) mit Ionenstrahl-Austrittsfenster (2) für einen konvergierenden zentrierten Ionenstrahl (3) und einem mechanischen Ausrichtsystem (4) für das abzutastende Zielvolumen (5),
dadurch gekennzeichnet,
daß das Ionenbeschleunigersystem auf eine für eine maximale Eindringtiefe notwendige Beschleunigung der Ionen einstellbar ist und das Abtastsystem (6) ein Energieabsorptionsmittel (7) aufweist, das in dem Ionenstrahlengang zwischen Zielvolumen (5) und Ionenstrahl-Austrittsfenster (2) quer zum Ionenstrahlzentrum angeordnet ist und quer zum Ionenstrahlzentrum zur Variation der Ionenstrahlenergie verschieblich ist, so daß eine Tiefenmodulation des Ionenstrahls (1), die mittels Linearmotor (8) unter Querverschiebung des Energieabsorptionsmittels (7) erfolgt, im Zielvolumen (5) mit einer in der Tiefe gestaffelten Abtastung von Volumenelementen (9) des Zielvolumens (5) in schneller Folge durchführbar ist.
2. Ionenstrahl-Abtastsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** daß das Zielvolumen (5) ein von gesundem Gewebe (10) umgebenes Tumorgewebe (11) ist, wobei die Eindringtiefe (12) des Ionenstrahls (3) durch die Energie der Ionen im Ionenstrahl (3) bestimmt ist und mittels der einstellbaren Beschleunigung der Ionen der tiefste Bereich des Tumorgewebes (11) erreichbar ist.

3. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Energieabsorptionsmittel (7) quer zum Ionenstrahlzentrum (17) verschiebbliche Absorberkeile (13) aufweist, die mit einem leistungsstarken Linearmotor (8) angetrieben werden, so daß eine strahlintensitäts-kontrollierte Tiefen-Rasterung vollzogen werden kann.
4. Ionenstrahl-Abtastsystem nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Abtastsystem ein elektronisches Steuersystem (14, 34) für den Linearantrieb der Absorberkeile (13) aufweist und eine Ionisationskammer (16) zum Messen der Teilchenrate des Strahles umfaßt und die Absorberkeile (13) nach Erreichen einer vorbestimmten Teilchenzahl, die für jeden Tiefenschritt verschieden sein kann, um einen Schritt, vorzugsweise von 10 µm bis 100 µm weiter zusammenfährt, so daß eine in der Tiefe gestaffelte Abtastung von Volumenelementen (9) des Zielvolumens (5) möglich ist.
5. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Energieabsorptionsmittel (7) mindestens zwei quer zum Ionenstrahlzentrum entgegengesetzt verschiebbliche Absorberkeile (13) aufweist.
6. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Energieabsorptionsmittel (7) zwei quer zum Ionenstrahlzentrum (17) gegeneinander verschiebbliche Absorberkeilpakete (18) aufweist.
7. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das System einen Randbegrenzer (20) mit verschiebblichen Blendenelementen (21) zwischen dem Zielvolumen (5) und dem Energieabsorptionsmittel (7) aufweist.

8. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Abtastsystem irisblendenartig einzeln verstellbare Randblenden (19) zur teilweisen Randbegrenzung des Ionenstrahls (3) in bezug auf das Zielvolumen aufweist.
9. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß es einen Patiententisch (22) aufweist, der das Zielvolumen (5) trägt und der während eines Bestrahlungsvorganges in einer Ebene quer zum Ionenstrahl (3) in zwei Koordinateneinrichtungen verschiebbar ist.
10. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß es einen Patiententisch (22) aufweist, der das Zielvolumen (5) trägt und der während eines Bestrahlungsvorganges in einer lateralen Richtung quer zum Ionenstrahl (3) verschiebbar ist und Ablenkungsmagnete (23, 24, 25) aufweist, der den Ionenstrahl (1) aus seiner Mittenposition am Austrittsfenster (2) quer zur lateralen Richtung des Patiententisches (22) ablenkt.
11. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Intensität der Ionenstrahlabtastung durch die Summenzahl der Ionen, die in einem Volumenelement (9) auftreffen, definiert ist.
12. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß es eine Ionisationskammer (16) zur Messung der Strahlintensität aufweist, die stromaufwärts vom Energieabsorptionsmittel (7) angeordnet ist.

13. Ionenstrahl-Abtastsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß es einen Patiententisch (22) aufweist, der das Zielvolumen (5) trägt und während einer Bestrahlung in einer lateralen Richtung quer zum Ionenstrahl (3) verschiebbar ist und ein Gantry-System (27) aufweist, das quer zur lateralen Bewegungsrichtung des Patiententisches (22) um eine Gantryrotationsachse drehbar ist.
14. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System (27) zum Ausrichten eines Ionenstrahls (3) auf ein Zielvolumen (5) nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Ionenstrahl (3) in der Gantryrotationsachse (28) dem Gantry-System (27) zugeführt und mittels Magnetoptiken (23, 24, 25) unter einstellbaren Winkeln von 0 bis 360° in einer Ebene orthogonal zur Gantryrotationsachse (28) auf ein Zielvolumen (5) ausrichtbar ist, so daß der Ionenstrahl (3) die Gantryrotationsachse (28) in einem Isozentrum (29) des Gantry-Systems (27) schneidet, wobei das Gantry-System (27) einen lateral in Richtung der Gantryrotationsachse (28) verschiebblichen Zielvolumenträger (30) aufweist, das Zielvolumen (5) stromaufwärts des Isozentrums (29) angeordnet ist und ein Energieabsorptionsmittel (7), das stromaufwärts in Radialrichtung des Gantry-Systems (27) angeordnet ist, eine Volumenelementrasterung in Tiefenrichtung des Gantry-Systems (27) eine Drehwinkel-Volumenelementrasterung in Seitenrichtung und der lateral verschiebbliche Zielvolumenträger (30) eine Volumenelementrasterung in Längsrichtung definieren und beliebig geformte Zielvolumen (5) durch Kombination dieser drei Rastermittel volumenelementweise rasterbar ist.
15. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System nach Anspruch 13 oder 14, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Zielvolumenträger (30) während der Bestrahlung unbewegt bleibt und Umlenkma-

- gneten (23, 24, 25) den Ionenstrahl (3) während der Bestrahlung in der Gantry-Ebene ablenkt.
16. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System nach einem der Ansprüche 13 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Energieabsorptionsmittel (7) tangential zum Drehkreis des Gantry-Systems (27) verschiebbliche Absorberkeile (13) aufweist.
 17. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System nach einem der Ansprüche 13 bis 16, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Energieabsorptionsmittel (7) mindestens zwei tangential zum Drehkreis des Gantry-Systems (27) entgegengesetzt verschiebbliche Absorberkeile (13) aufweist.
 18. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System nach einem der Ansprüche 13 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Energieabsorptionsmittel (7) radial gestaffelte tangential zum Drehkreis des Gantry-Systems (27) verschiebbliche Absorberkeilpakete (18) aufweist.
 19. Ionenstrahl-Abtastsystem mit Gantry-System nach einem der Ansprüche 13 bis 18, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein zentraler Bereich des Zielvolumens (5) um mindestens ein Fünftel des Gantry-Systemradius stromaufwärts des Isozentrums (29) angeordnet ist, so daß das Zielvolumen (9) selbst nicht im Isozentrum (29) liegt.
 20. Verfahren zum Ionenstrahl-Abtasten mittels einer Ionenquelleinrichtung, einem Ionenbeschleunigersystem und einer Ionenstrahlführung (1) mit Ionenstrahl-Austrittsfenster (2) für einen konvergierenden zentrierten Ionenstrahl (3) und einem mechanischen Ausrichtsystem (4) für das abzutastende Zielvolumen (5),

gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

- Einstellen des Ionenbeschleunigersystems auf eine für eine maximale Eindringtiefe (12) notwendige Beschleunigung der Ionen,
- Erfassen der Ionenstrahlintensität,
- Querverschieben eines Energieabsorbtiionsmittels (7) mit unterschiedlicher Materialstärke zur Tiefenmodulation des Ionenstrahls (3),
- Aufsummieren der Bestrahlungsionen eines Volumenelements (9) eines Zielvolumens (5) bis zu einer vorgegebenen Bestrahlungsdosis,
- Ändern der Eindringtiefe des Ionenstrahls (3) mittels Querverschiebung des Energieabsorptionsmittels (7) nach Erreichen der vorgegebenen Bestrahlungsdosis des Volumenelementes (9) zur Bestrahlung eines nächsten stromaufwärts liegenden Volumenelementes.

21. Verfahren nach Anspruch 20, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein elektronisches Steuersystem (14) für den Linearantrieb der Absorberkeile (13) die Teilchenrate des Strahles mittels einer Ionisationskammer (16) und die Absorberkeile (13) nach Erreichen einer vorbestimmten Teilchenrate, die für jeden Tiefenschritt unterschiedlich sein kann, um einen Schritt, vorzugsweise um 10 bis 100 μm , weiter zusammenfährt, so daß eine in der Tiefe gestaffelte Abtastung von Volumenelementen (9) des Zielvolumens (5) erfolgt.
22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Intensität zwischen 10^6 und 10^8 absorbierten Ionen pro Volumeneinheit beim Abrastern des Zielvolumens (5) eingestellt wird.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 22, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Abtastung des Zielvolumenvolumens (5) kontinuierlich fortschreitet.
24. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 23, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Abtastung des Zielvolumenvolumens (5) in Tiefenrichtung säulenförmig erfolgt.
25. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 24, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Abtastung des Zielvolumenvolumens (5) schrittweise fortschreitet.
26. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 25, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Abtastung des Zielvolumenvolumens (5) in Tiefenrichtung kontinuierlich und in Seitenrichtung und Längsrichtung schrittweise erfolgt.
27. Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 26, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Abtastung des Zielvolumenvolumens (5) in Tiefenrichtung und Seitenrichtung kontinuierlich und in Längsrichtung schrittweise erfolgt.
28. Verfahren zum Betreiben eines Ionenstrahl-Abtastsystems nach einem der Ansprüche 20 bis 27 unter Verwendung eines Gantry-Systems (27) zum Ausrichten eines Ionenstrahls (3) auf ein Zielvolumen (5), wobei der Ionenstrahl (3) in der Rotationsachse dem Gantry-System (27) zugeführt und mittels Magnetoptiken (23, 24, 25) unter einstellbaren Winkeln von 0 bis 360° in einer Ebene orthogonal zur Gantryrotationsachse (28) auf ein Zielvolumen (5) ausgerichtet wird, so daß der Ionenstrahl (3) die Gantryrotationsachse (28) in einem Isozentrum (29) des Gantry-Systems (27) schneidet, wobei das Gantry-System (27) einen lateral in Richtung der

Gantryrotationsachse (29) verschieblichen Zielvolumenträger (30) aufweist,

gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

Anordnen des Zielvolumens (5) stromaufwärts des Isozentrums (29),

Volumenelementrastern in Tiefenrichtung mittels eines Energieabsorptionsmittels (7), das stromaufwärts in Radialrichtung des Gantry-Systems (27) angeordnet ist,

Volumenelementrastern in Seitenrichtung mittels Drehwinkeländerung des Gantry-Systems (27) und

Volumenelementrastern in Längsrichtung mittels Lateralverschiebung des Zielvolumenträgers (30).

29. Verfahren zum Betreiben eines Ionenstrahl-Abtastsystems nach einem der Ansprüche 20 bis 27 unter Verwendung eines Gantry-Systems (27), bei dem ein Zielvolumenträger (30) vor der Bestrahlung ausgerichtet wird und während der Bestrahlung unbeweglich bleibt und der Ionenstrahl (3) mittels der letzten Gantry-Umlenk-Magnete (23, 24, 25) in der Gantry-Ebene zur Volumenelementrasterung in Längsrichtung abgelenkt wird.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

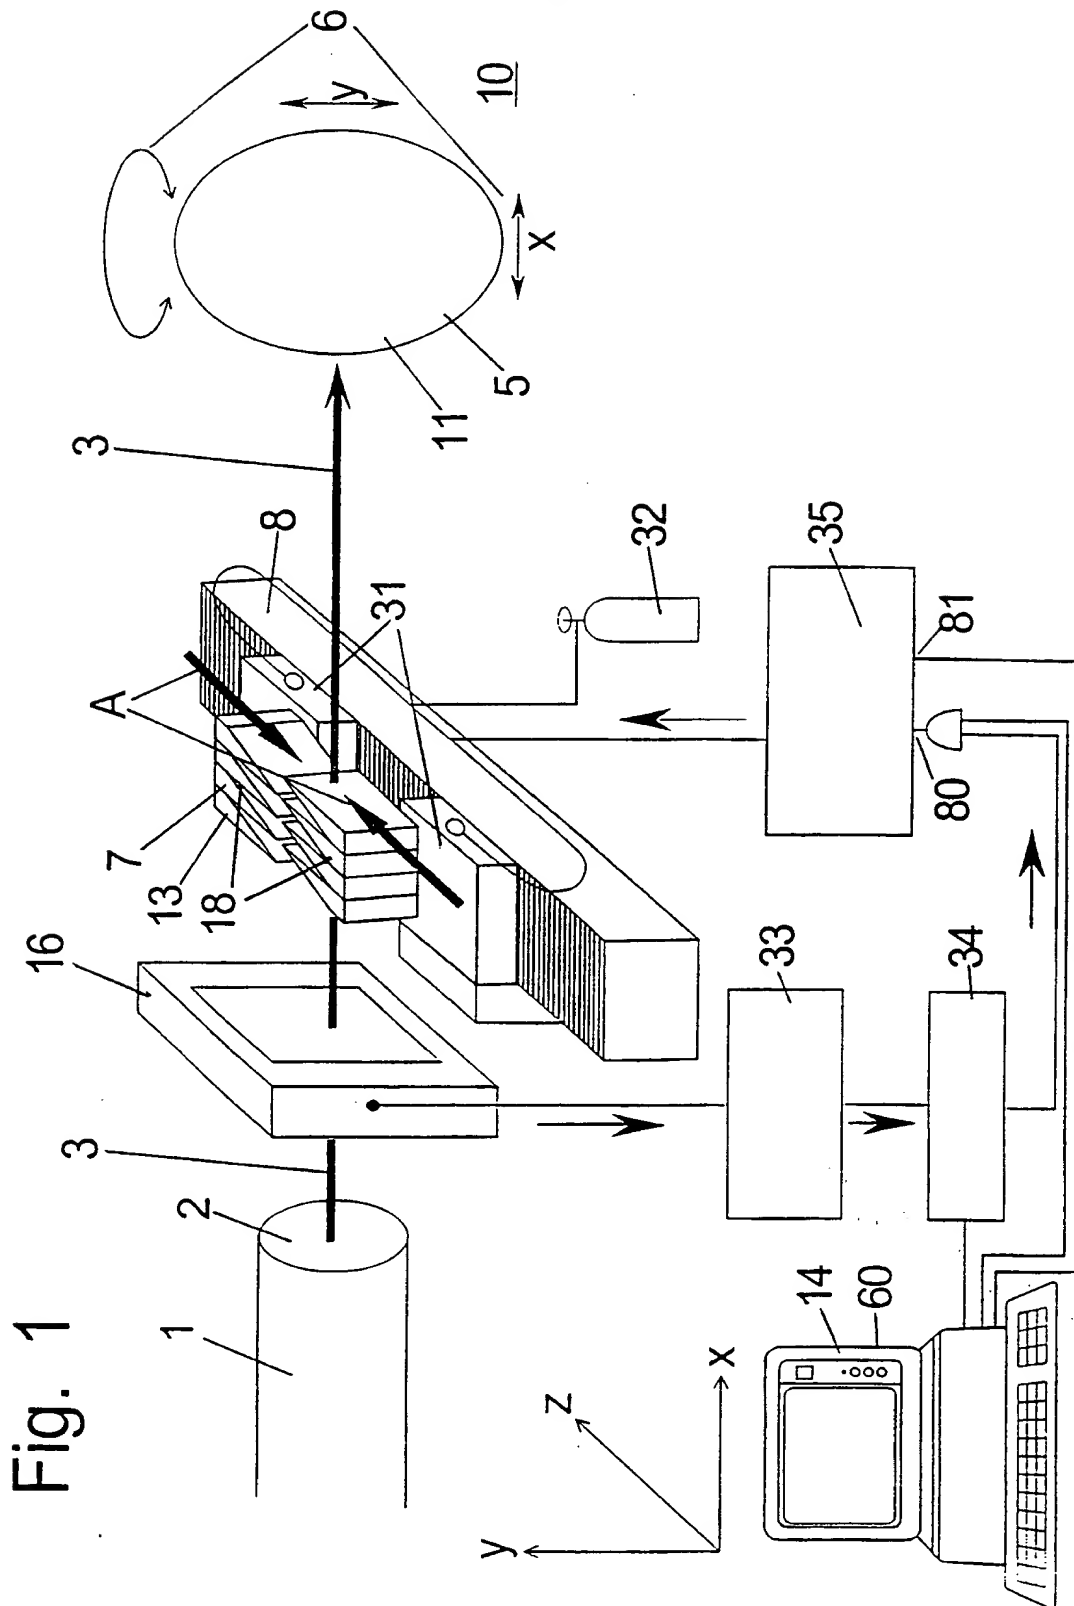


Fig. 1

THIS PAGE BLANK (USPTO)


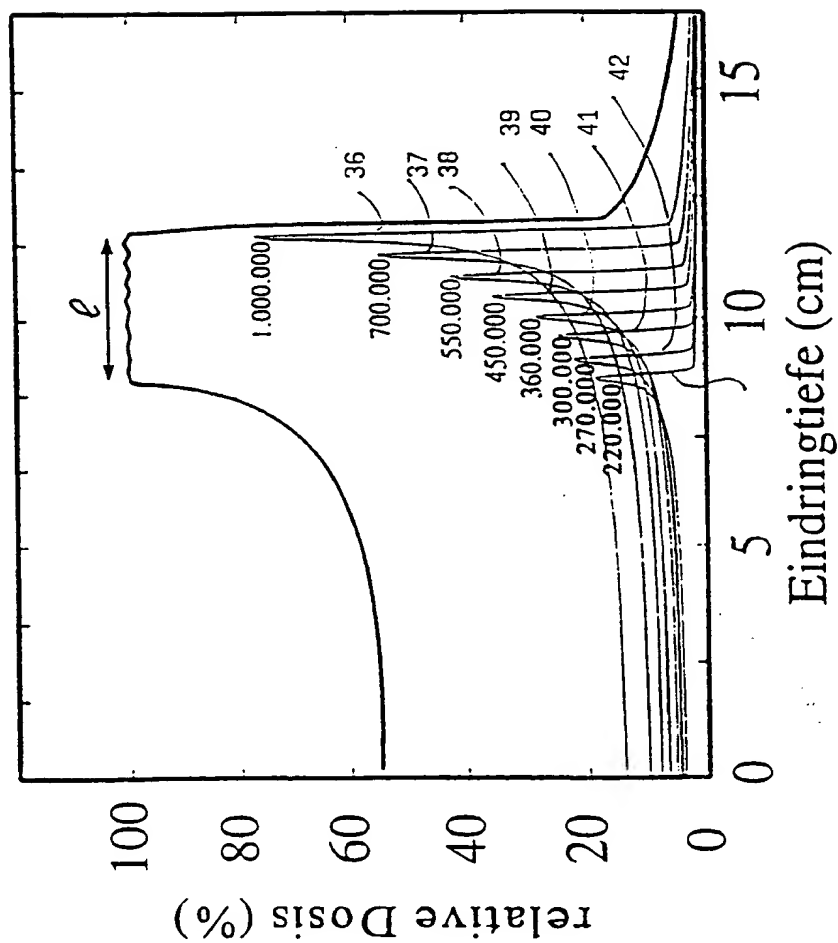


Fig. 2

THIS PAGE BLANK (usr)

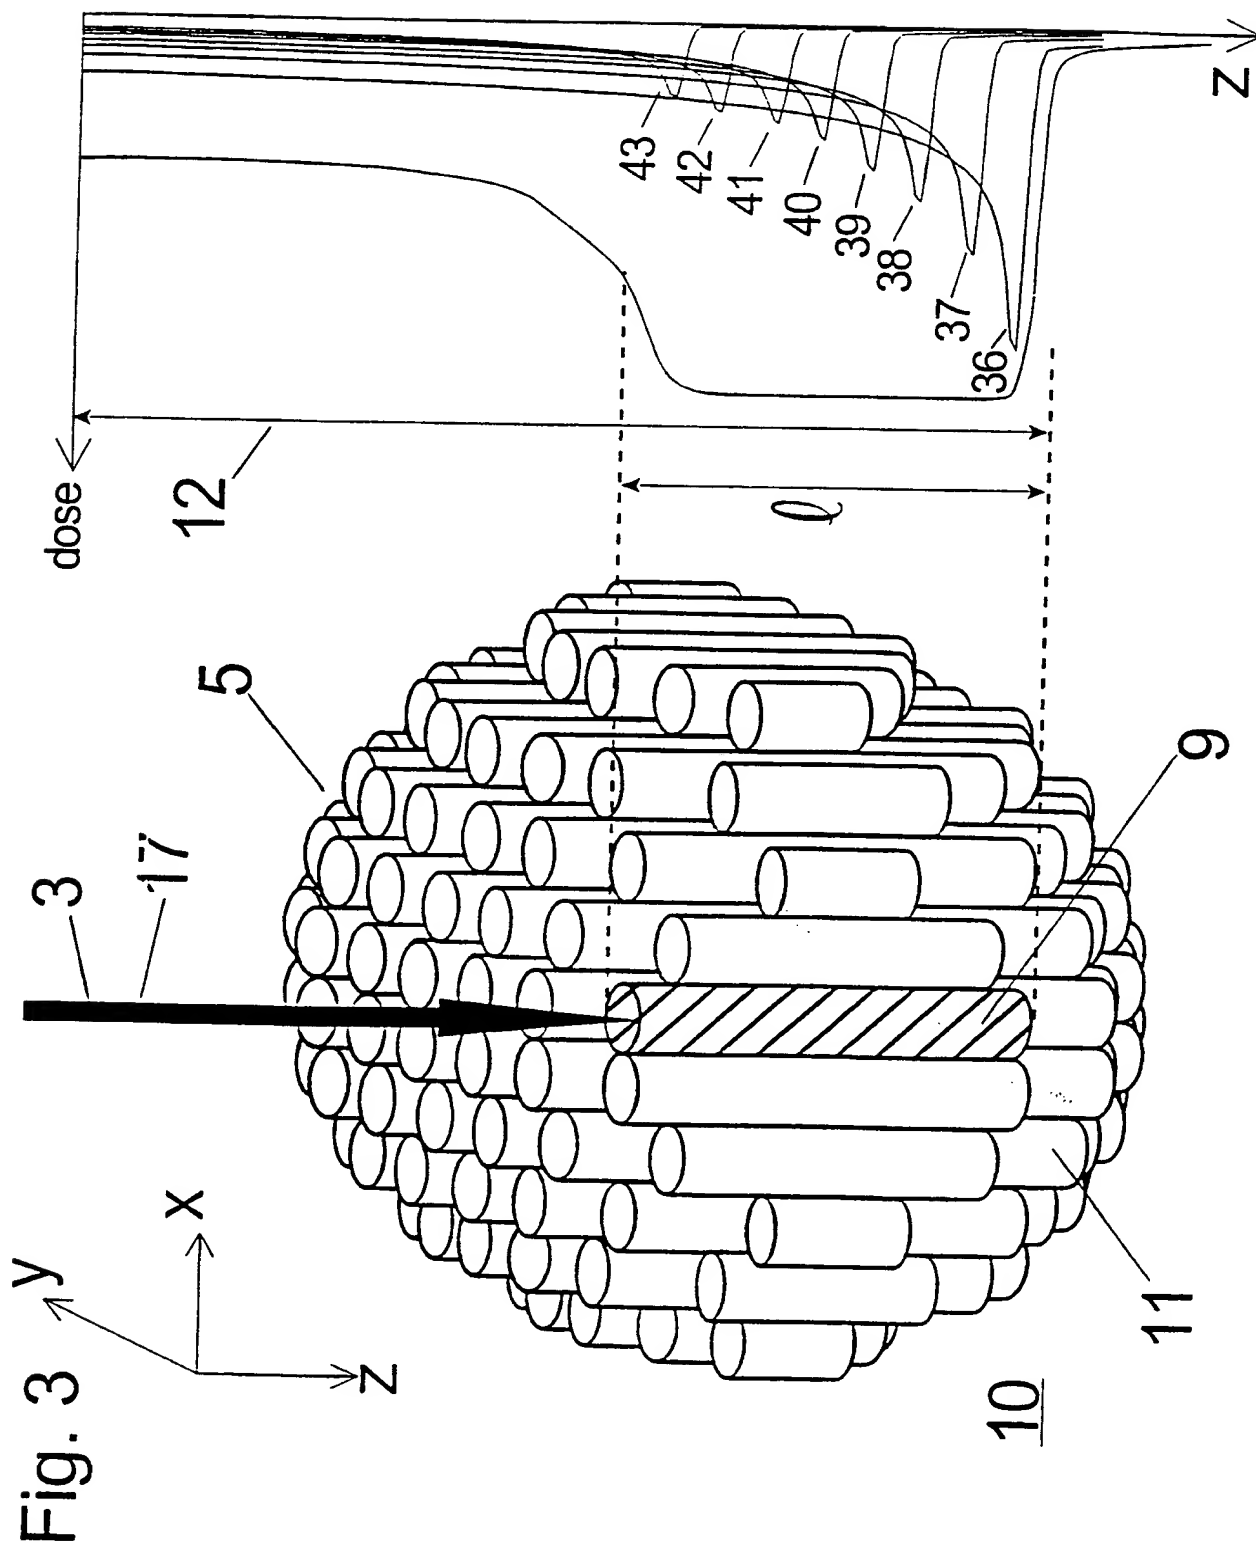

THIS PAGE BLANK

Fig. 8





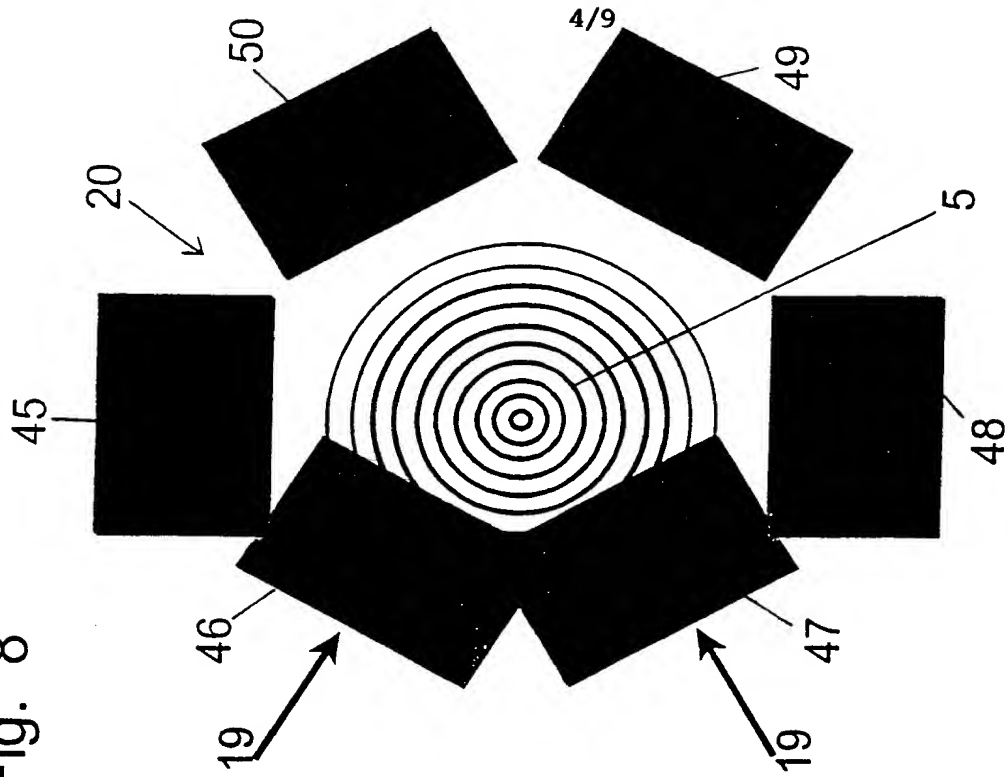


Fig. 7

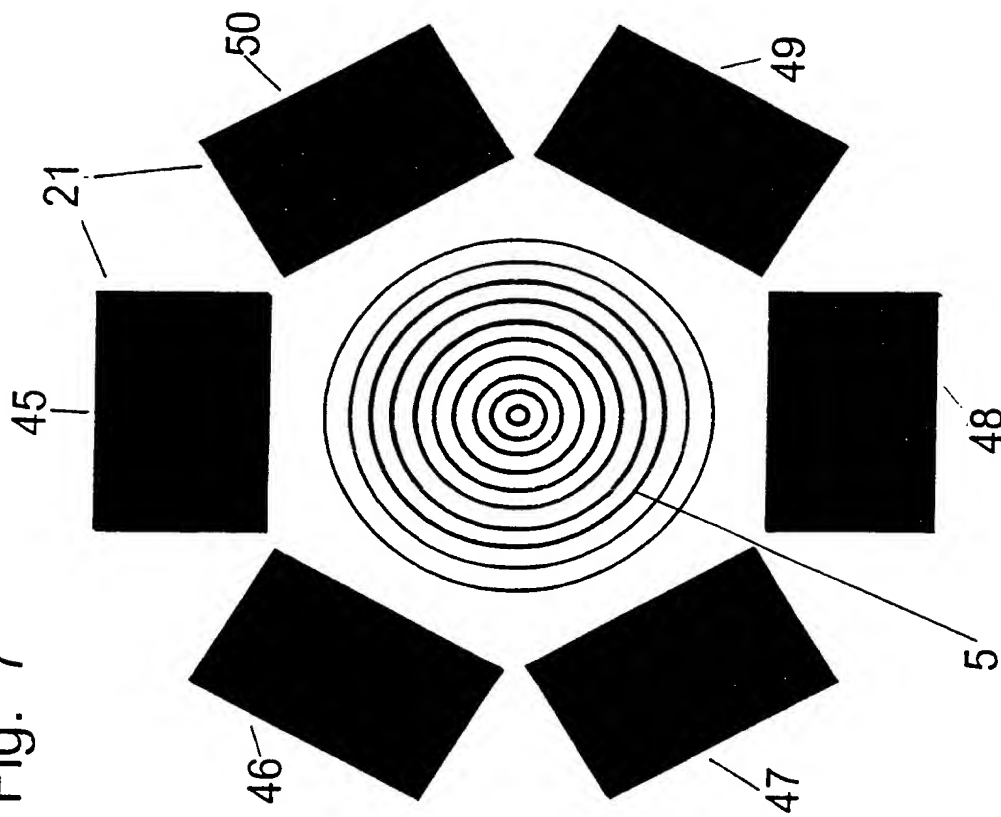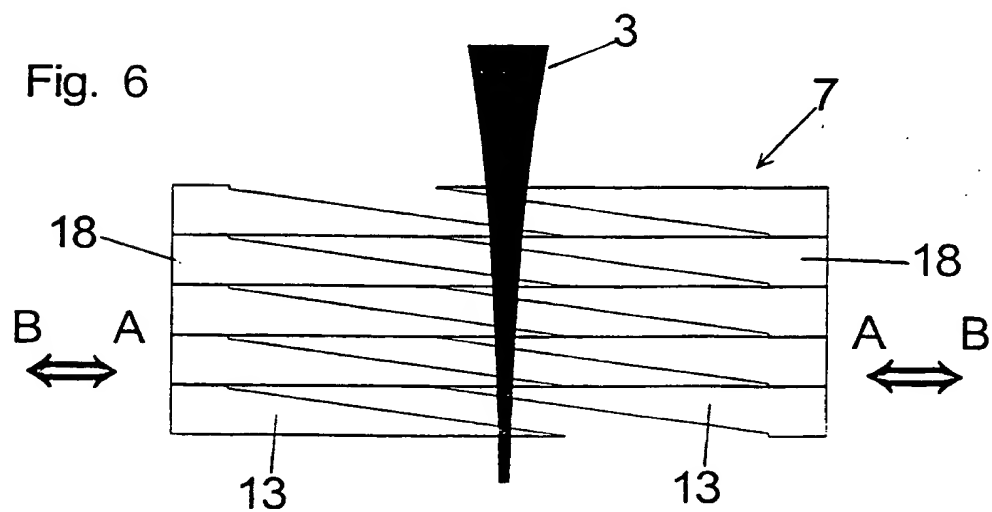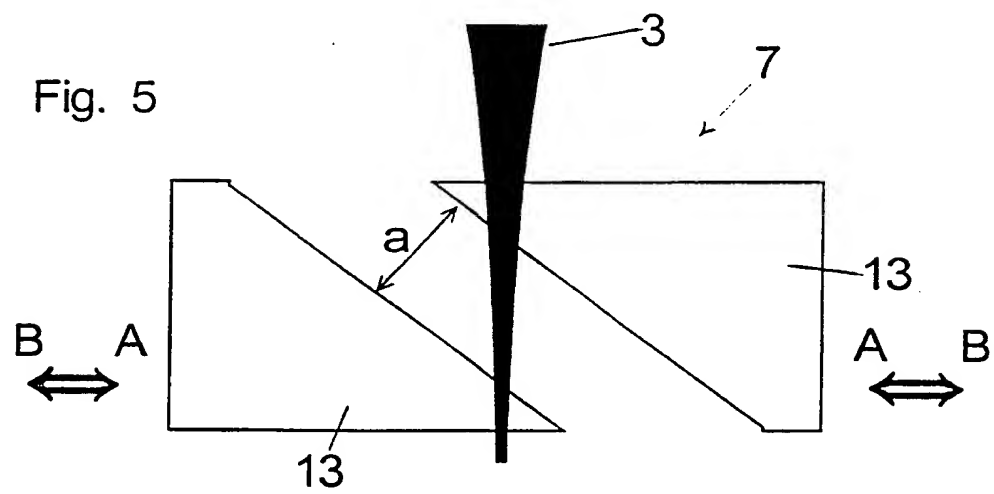


THIS PAGE BLANK

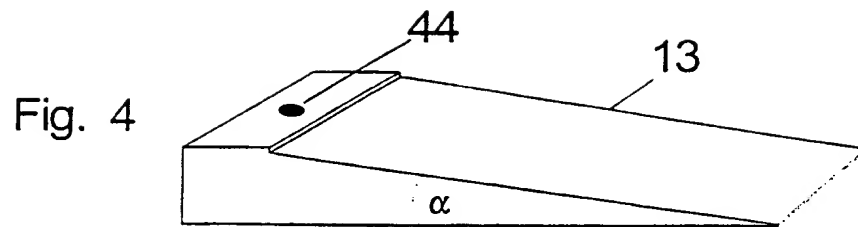


THIS PAGE BLANK (USP)


Fig. 9

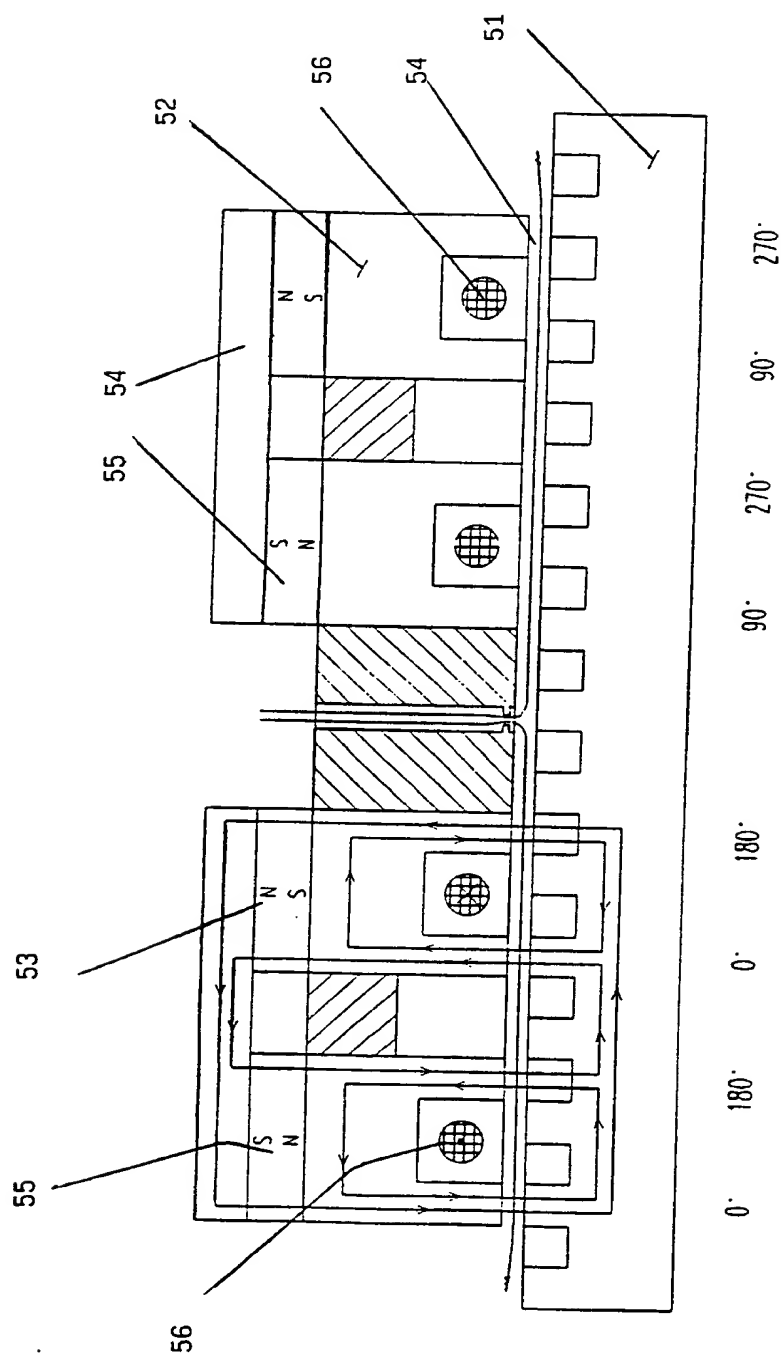

THIS PAGE BLANK (USPTO)

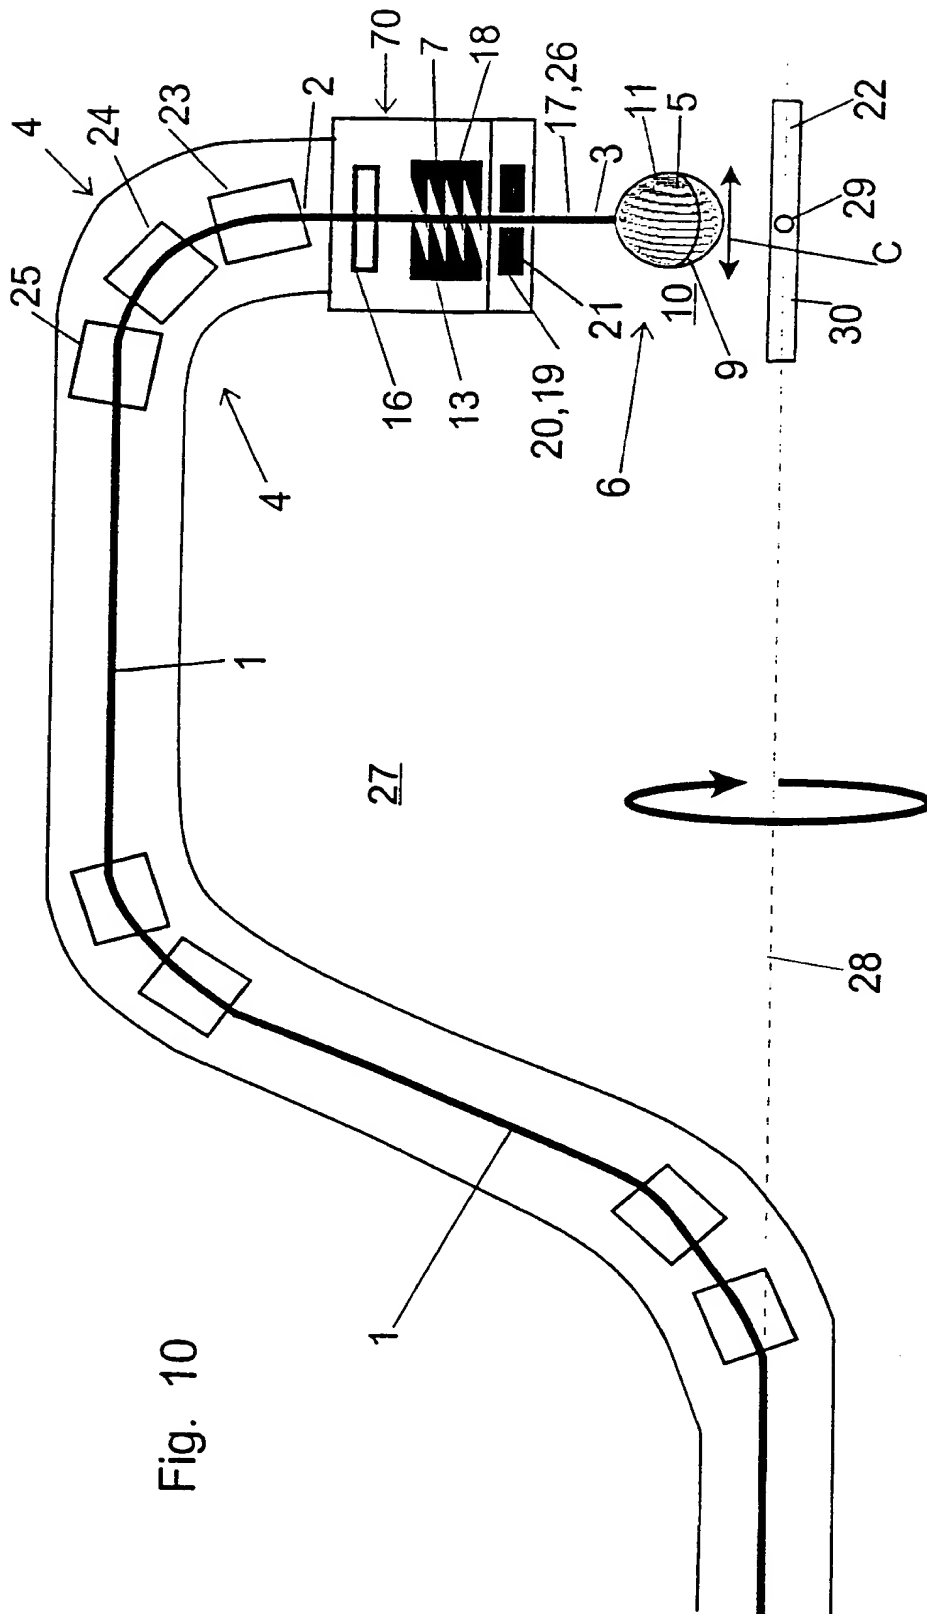

THIS PAGE BLANK (USPTO)

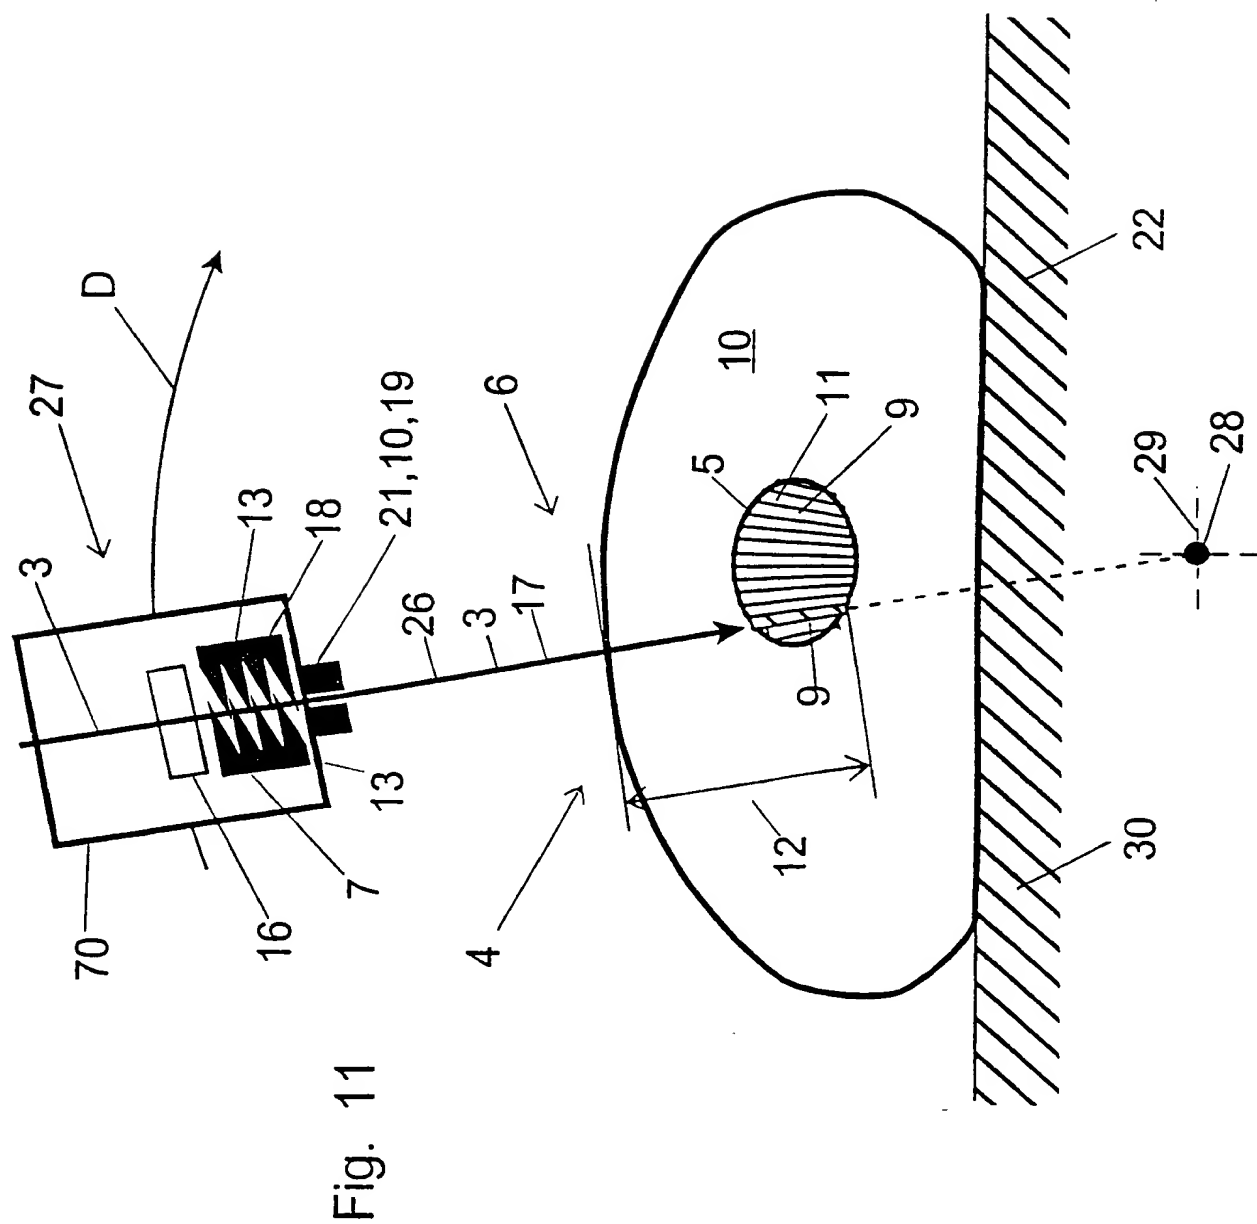

THIS PAGE BLANK (USPTO)

9/9

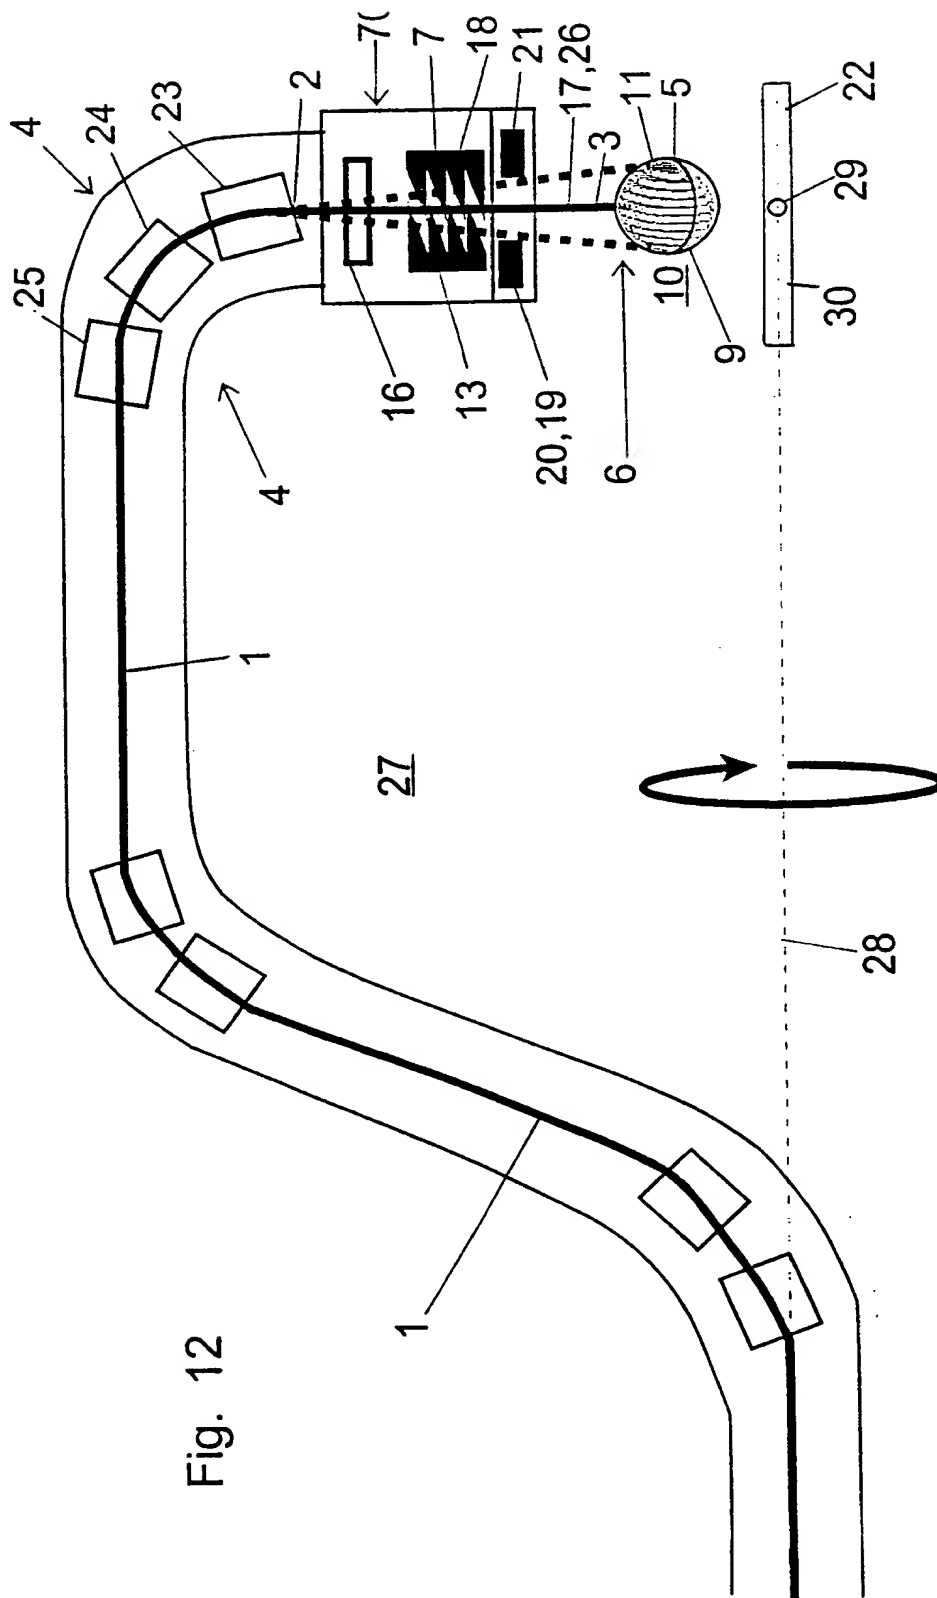


Fig. 12

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 00/01149

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G21K1/04 A61N5/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G21K A61N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 779 081 A (HITACHI LTD) 18 June 1997 (1997-06-18) column 3, line 5 - line 15	1-3, 5, 20
Y	column 3, line 51 - line 56 column 4, line 44 - line 48 column 5, line 33 - line 37 column 7, line 54 - column 8, line 12	6, 9
A	figures 1,6	4, 10, 11, 13-15, 21, 28, 29
Y	--- EP 0 417 965 A (GEN ELECTRIC) 20 March 1991 (1991-03-20) column 9, line 37 - column 10, line 39 figures 5-7A --- -/-	6

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 June 2000

Date of mailing of the international search report

06/07/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Capostagno, E

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l. Application No.
PCT/EP 00/01149

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	GB 1 362 678 A (VARIAN ASSOCIATES) 7 August 1974 (1974-08-07) page 2, line 54 - line 66 figure 1 ---	9
A	WO 96 19262 A (ELEKTA AB ;BACKMAN PER (SE)) 27 June 1996 (1996-06-27) page 2, line 13 -page 3, line 23 figure 3 ---	7
A	EP 0 094 278 A (THOMSON CSF) 16 November 1983 (1983-11-16) the whole document ---	8
A	EP 0 223 432 A (WANG SHIH PING) 27 May 1987 (1987-05-27) column 11, line 46 -column 12, line 5 figure 8 -----	1,3,20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int. l. Application No

PCT/EP 00/01149

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0779081	A	18-06-1997	JP 2833602 B	09-12-1998
			JP 9223600 A	26-08-1997
EP 0417965	A	20-03-1991	US 4998270 A	05-03-1991
			CA 2014920 A	06-03-1991
			JP 1848981 C	07-06-1994
			JP 3149036 A	25-06-1991
			JP 5055131 B	16-08-1993
GB 1362678	A	07-08-1974	CA 932883 A	28-08-1973
			DE 2158535 A	08-06-1972
			FR 2115423 A	07-07-1972
			IT 941769 B	10-03-1973
			NL 7116402 A	30-05-1972
			US 3720817 A	13-03-1973
			CA 939081 A	25-12-1973
			GB 1362679 A	07-08-1974
			US 3783251 A	01-01-1974
			CA 951031 A	09-07-1974
WO 9619262	A	27-06-1996	SE 508661 C	26-10-1998
			EP 0843578 A	27-05-1998
			SE 9404405 A	20-06-1996
EP 0094278	A	16-11-1983	FR 2526215 A	04-11-1983
			DE 3361543 D	30-01-1986
			US 4510613 A	09-04-1985
EP 0223432	A	27-05-1987	CA 1244971 A	15-11-1988
			JP 2913425 B	28-06-1999
			JP 5329138 A	14-12-1993
			JP 2562734 B	11-12-1996
			JP 5329139 A	14-12-1993
			JP 2849879 B	27-01-1999
			JP 5329140 A	14-12-1993
			JP 5080906 B	10-11-1993
			JP 62129034 A	11-06-1987
			JP 11164828 A	22-06-1999
			US 4953189 A	28-08-1990
			US 5054048 A	01-10-1991

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In: .tionales Aktenzeichen

PCT/EP 00/01149

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G21K1/04 A61N5/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 G21K A61N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 779 081 A (HITACHI LTD) 18. Juni 1997 (1997-06-18) Spalte 3, Zeile 5 - Zeile 15	1-3,5,20
Y	Spalte 3, Zeile 51 - Zeile 56 Spalte 4, Zeile 44 - Zeile 48 Spalte 5, Zeile 33 - Zeile 37 Spalte 7, Zeile 54 - Spalte 8, Zeile 12	6,9
A	Abbildungen 1,6	4,10,11, 13-15, 21,28,29
Y	--- EP 0 417 965 A (GEN ELECTRIC) 20. März 1991 (1991-03-20) Spalte 9, Zeile 37 - Spalte 10, Zeile 39 Abbildungen 5-7A --- -/-	6



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

30. Juni 2000

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

06/07/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Capostagno, E

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int donales Aktenzeichen

PCT/EP 00/01149

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	GB 1 362 678 A (VARIAN ASSOCIATES) 7. August 1974 (1974-08-07) Seite 2, Zeile 54 - Zeile 66 Abbildung 1 ----	9
A	WO 96 19262 A (ELEKTA AB ;BACKMAN PER (SE)) 27. Juni 1996 (1996-06-27) Seite 2, Zeile 13 -Seite 3, Zeile 23 Abbildung 3 ----	7
A	EP 0 094 278 A (THOMSON CSF) 16. November 1983 (1983-11-16) das ganze Dokument ----	8
A	EP 0 223 432 A (WANG SHIH PING) 27. Mai 1987 (1987-05-27) Spalte 11, Zeile 46 -Spalte 12, Zeile 5 Abbildung 8 -----	1,3,20

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/01149

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0779081 A	18-06-1997	JP 2833602 B JP 9223600 A	09-12-1998 26-08-1997
EP 0417965 A	20-03-1991	US 4998270 A CA 2014920 A JP 1848981 C JP 3149036 A JP 5055131 B	05-03-1991 06-03-1991 07-06-1994 25-06-1991 16-08-1993
GB 1362678 A	07-08-1974	CA 932883 A DE 2158535 A FR 2115423 A IT 941769 B NL 7116402 A US 3720817 A CA 939081 A GB 1362679 A US 3783251 A CA 951031 A US 3777124 A	28-08-1973 08-06-1972 07-07-1972 10-03-1973 30-05-1972 13-03-1973 25-12-1973 07-08-1974 01-01-1974 09-07-1974 04-12-1973
WO 9619262 A	27-06-1996	SE 508661 C EP 0843578 A SE 9404405 A	26-10-1998 27-05-1998 20-06-1996
EP 0094278 A	16-11-1983	FR 2526215 A DE 3361543 D US 4510613 A	04-11-1983 30-01-1986 09-04-1985
EP 0223432 A	27-05-1987	CA 1244971 A JP 2913425 B JP 5329138 A JP 2562734 B JP 5329139 A JP 2849879 B JP 5329140 A JP 5080906 B JP 62129034 A JP 11164828 A US 4953189 A US 5054048 A	15-11-1988 28-06-1999 14-12-1993 11-12-1996 14-12-1993 27-01-1999 14-12-1993 10-11-1993 11-06-1987 22-06-1999 28-08-1990 01-10-1991

THIS PAGE BLANK (USPTO)